



# EXPRESSPOLY

## GUIDE 2025



# *Sommaire*

## ITEM 1

### *Expresspoly & vous*

- Présentation de l'entreprise .....05
- Contact .....05
- Service .....06
- Condition générale .....06
- Application .....07
- Notre SAV .....08

## ITEM 2

### *Sommeil*

- Polygraphie .....10
- Polysomnographie .....11
- Chambre du sommeil .....22

## ITEM 3

*Capnographie* .....33

## ITEM 4

### *Respiratoire*

- Spirométrie .....37
- Plethysmographie .....38
- PulmOne – Plethysmographie sans cabine .....39
- Feno .....40
- PeakFlow .....41

**ITEM 5**

*VO2 test d’effort* .....43

**ITEM 6**

*Gazomètre* .....45

**ITEM 7**

*Echographe* ..... 48

**ITEM 8**

*Electrocardiographe* .....50

**ITEM 9**

*Instruments médicaux*

- *Oxymètre* .....53
- *Tensiomètre* ..... 54
- *Stéthoscope* ..... 55
- *Thermomètre* .....56

**ITEM 10**

*Hygiène & entretien* ..... 57

*Item 1*

*Expresspoly & vous*

## Présentation de l'entreprise

Fondée en 2018, **EXPRESSPOLY** est une entreprise française spécialisée dans la location de matériel de diagnostic ainsi que la vente de consommables destinés aux professionnels de la santé. Notre objectif est de répondre au mieux aux demandes de nos clients en matière de diagnostic en étant à leur écoute.

Nous avons compris l'importance de la médecine de précision grâce à nos collaborations avec les médecins. Ainsi, nous mettons à leur disposition toutes nos connaissances techniques et les accompagnons au quotidien. Nos partenariats avec les leaders reconnus sur le marché du diagnostic nous permettent de proposer un large choix d'équipement de qualité.

Nous proposons des modes de paiement adaptés à vos besoins tels que le prélèvement, le virement ou le chèque. Nous livrons le matériel partout en France avec un délai de 24 à 48 heures.

## Contact

### **Adresse**

ZAC Euro 2000

4 Avenue de la Dame

30132 Caissargues

Nous sommes joignables au :

**04.49.230.830**

- |                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| - Commande Accessoire / Consommable :   | OPTION 1 |
| - Service SAV :                         | OPTION 2 |
| - Service Administratif / Facturation : | OPTION 3 |

## Service



Disposition d'un équipement similaire dans le cadre d'une location



Hotline SAV de 8h00 à 18h00



Proximité, réactivité & restitution rapide sous 24 à 48h



Diagnostic rapide sous 48h dès réception du matériel



Assistance dépannage à distance via interface web

## Condition générale

### *Validité de l'offre*

Conditions applicables à compter du 01 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.

### *Condition de transport*

Franco de port pour toute commande à partir de 100€ T.T.C.

Forfait à 5,00€ T.T.C. pour toute commande inférieure à 100€ T.T.C.

### *Garantie*

Tous les équipements neufs (hors consommables et accessoires) sont garantis 2 ans.

Tous les équipements loués (hors consommables et accessoires) sont garantis durant le temps de location.

### *Condition de règlement*

Règlement par virement, chèque ou prélèvement à 30 jours de la fin du mois. Il n'est pas pratiqué d'escompte pour paiement anticipé.

### *Taux de TVA*

Les tarifs TTC sont établis sur la base du taux de **TVA à 20%**. (Possibilité de demande de prix avec une TVA réduite)

# Application




ETAPE 1 - JE ME CONNECTE AU SITE [www.expresspoly.fr](http://www.expresspoly.fr)

ETAPE 2 - J'INSTALLE MON APPLICATION


Je clic sur les 3 petits points  
en haut à droite (1)



Je sélectionne  
« Ajouter à l'écran d'accueil » (2)

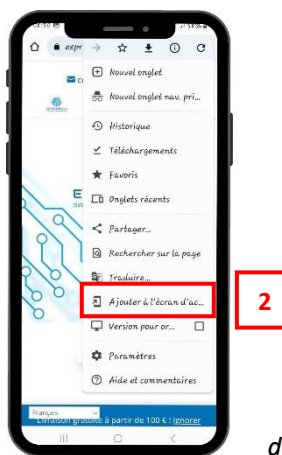

Je nomme l'application « Expresspoly » (3)  
puis je valide en cliquant sur « Ajouter » (4)

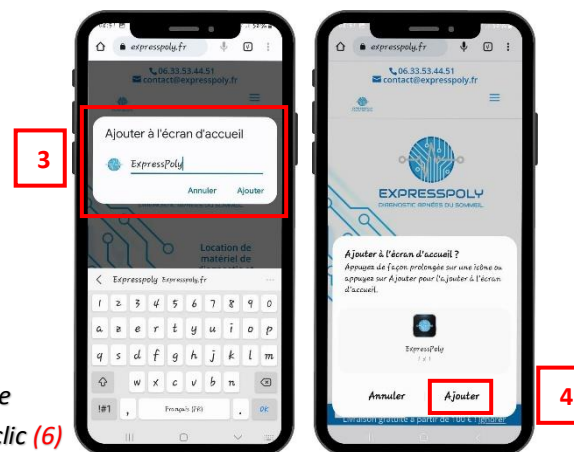

Mon application apparait  
sur ma page d'accueil (5)




Je peux ainsi passer ma commande  
de consommables ou accessoires en 1 clic (6)



## Notre Service après-vente

### Client

### Expresspoly

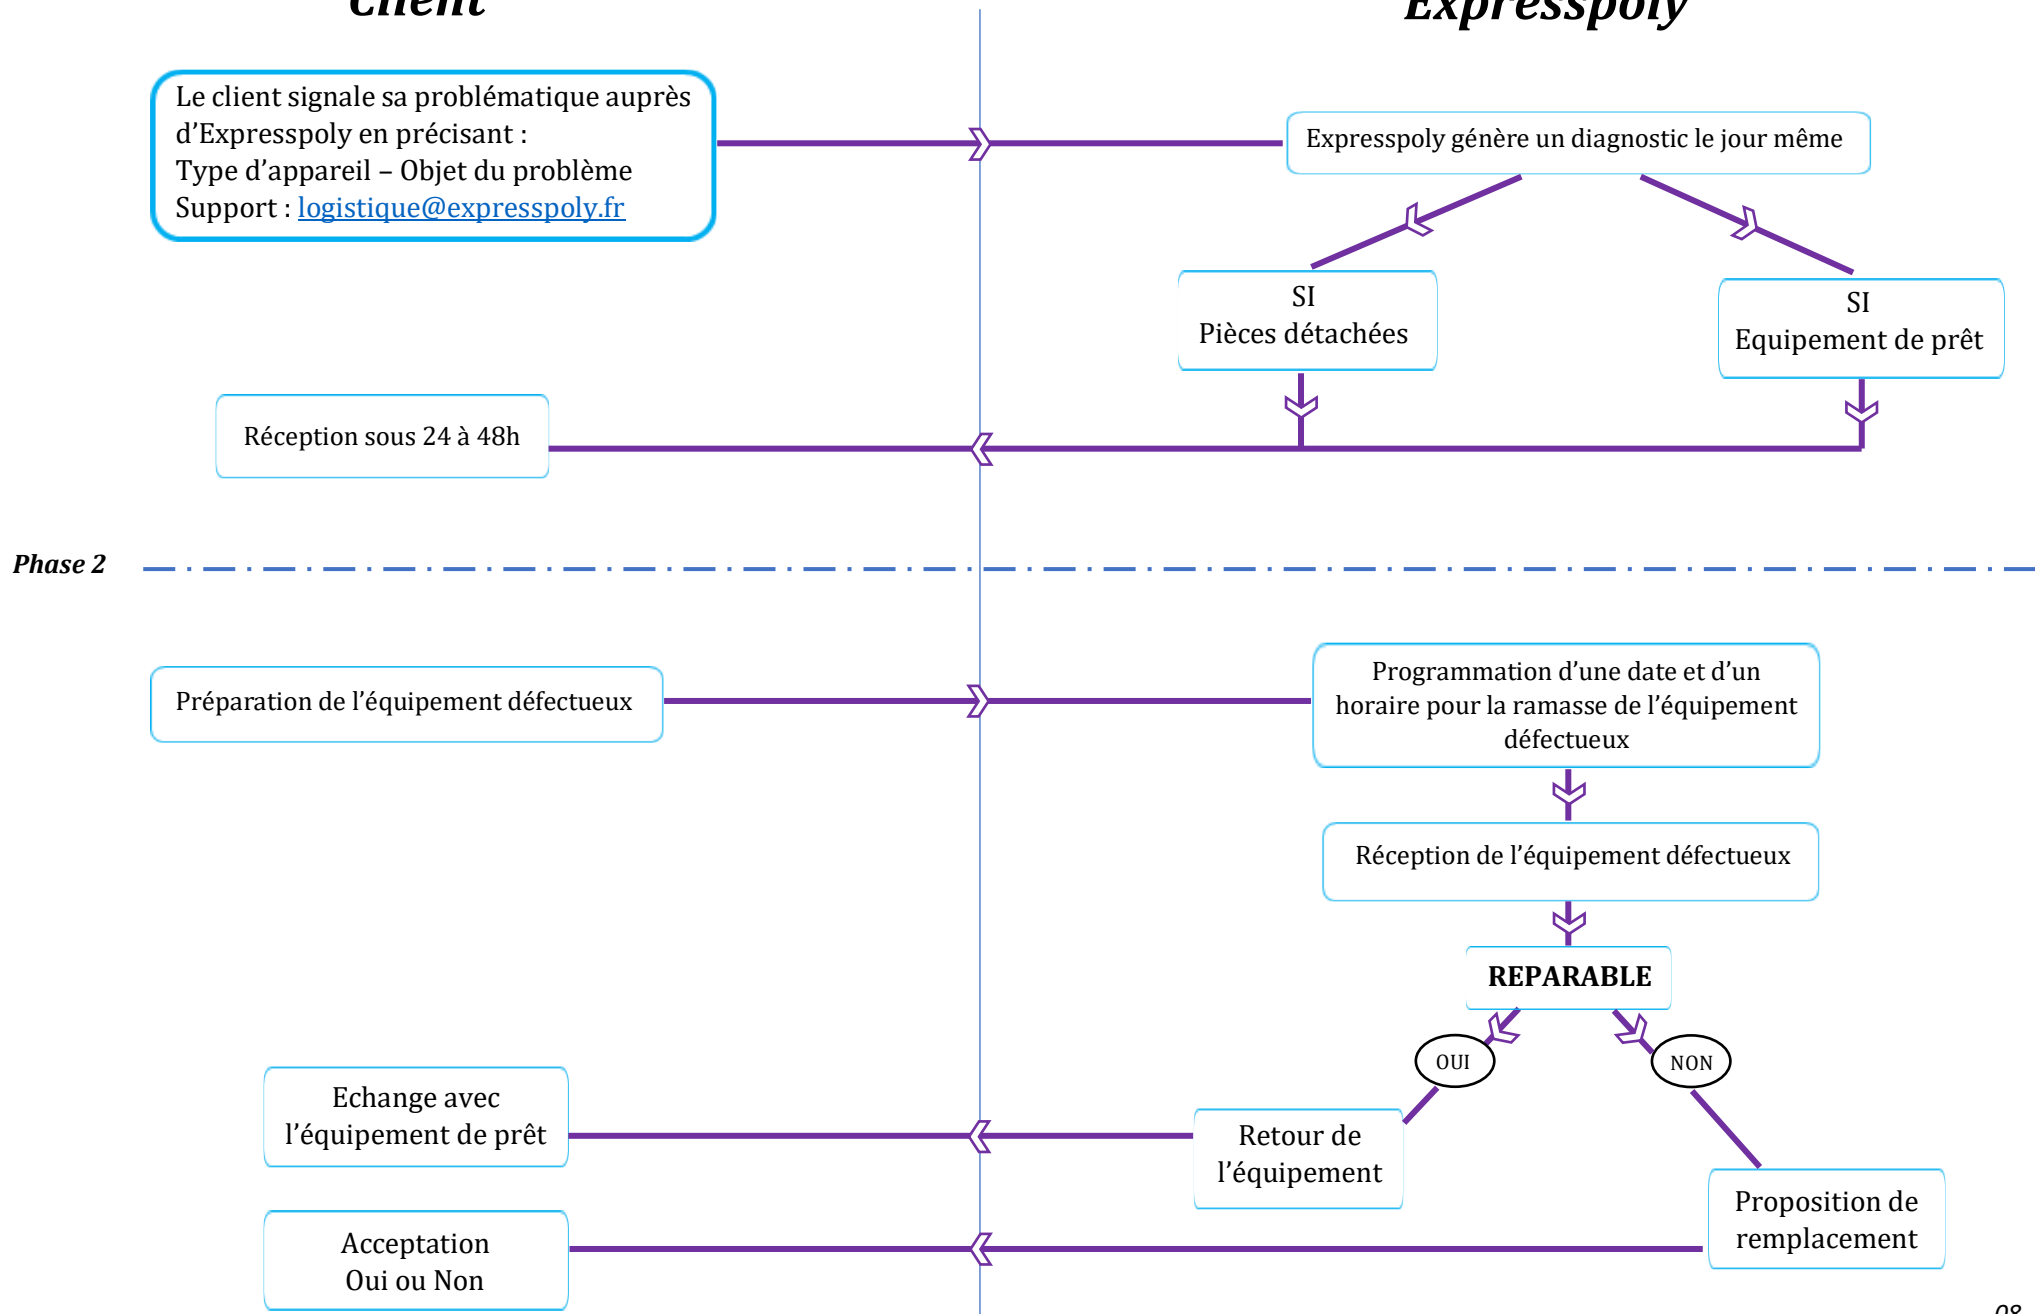

# *Item 2*

## *Sommeil*

# POLYGRAPHIE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|  | RESMED      | NOX T3S                                   |
|  | LOWENSTEIN  | SAMOA                                     |
|  | LOWENSTEIN  | SCALA                                     |
|  | CIDELEC     | <b>Nouveauté</b><br>HYPNEA 3 - HYPNOLIGHT |
|  | SEFAM       | SOMNOTOUCH RESP.                          |
|  | DUOMED      | <b>Nouveauté</b><br>FALCON                |

*\*le polygraphe CID LX & CID Lxa sont disponible jusqu'à Avril 2025*

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                     | Arbre          | Tarif    | Activité(s) | Actif        |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| GLQP007 | Polygraphie respiratoire nocturne | <u>6.1.7.4</u> | 148,80 € | 1           | 01/01/2025 → |
| GLQP007 | Polygraphie respiratoire nocturne | <u>6.1.7.4</u> | 151,68 € | 1           | 01/07/2025 → |
|         |                                   |                |          |             |              |

# POLYSOMNOGRAPHIE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | RESMED      | NOX A1S          |
|  | LOWENSTEIN  | SONATA           |
|  | CIDELEC     | CID Lxe          |
|  | SEFAM       | SOMNOTOUCH RESP. |

## **Cotation – Remboursement** (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                 | Arbre          | Tarif    | Activité(s) | Actif        |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| AMQP014 | Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo | <u>1.1.1.6</u> | 250,52 € | 1           | 01/01/2025 → |
| AMQP014 | Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo | <u>1.1.1.6</u> | 254,79 € | 1           | 01/07/2025 → |
| AMQP012 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo  | <u>1.1.1.6</u> | 217,99 € | 1           | 01/01/2025 → |
| AMQP012 | Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo  | <u>1.1.1.6</u> | 221,71 € | 1           | 01/07/2025 → |
| AMQP010 | Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo   | <u>1.1.1.6</u> | 136,32 € | 1           | 01/01/2025 → |
| AMQP010 | Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo   | <u>1.1.1.6</u> | 136,32 € | 1           | 01/07/2025 → |

## CANULE NASALE

|             | Désignation Produit                                                            | Référence                                                                                  |    | POLYGRAPHE |          |        |     |       |       | POLYSOMNOGRAPHIE |     |     |        | Cdt |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------|-----|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|-----|-----------|
|             |                                                                                |                                                                                            | T3 | T3S        | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno            | A1S | Lxe | Sonata |     | Somno PSG |
| Pédiatrique | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>180cm</b> (Spécial nouveau-né) | NC-020                                                                                     |    |            |          |        |     |       |       |                  |     |     |        | U   |           |
|             | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>60cm</b>                       | 15804-2                                                                                    |    |            | ⊗        | ⊗      |     |       |       |                  |     |     |        | U   |           |
|             | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>180cm</b>                      | NC-021                                                                                     |    |            |          |        |     |       |       |                  |     |     |        | U   |           |
|             | Lunette nasale <b>THERMOCAN</b> Luer Lock en longueur de tube <b>60cm</b>      | 15816-2                                                                                    |    |            | ⊗        | ⊗      |     |       | ⊗     |                  | ⊗   |     | ⊗      | U   |           |
|             | Lunette <b>Bucco-nasale</b> Luer Lock en longueur de tube <b>180cm</b>         | NC-028                                                                                     |    |            |          |        |     |       |       |                  |     |     |        | U   |           |
|             | Filtre pour lunette nasale                                                     | 7072097                                                                                    |    |            | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗                |     | ⊗   | ⊗      | ⊗   | U         |
| Adulte      | Lunette nasale <b>AVEC</b> filtre en longueur de tube <b>40cm</b>              |  EP60-F   |    |            | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗                |     | ⊗   | ⊗      | ⊗   | U         |
|             | Lunette nasale <b>AVEC</b> filtre en longueur de tube <b>40cm</b>              |  7072074  |    |            | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗                |     | ⊗   | ⊗      | ⊗   | U         |
|             | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>60cm</b>                       | EP60-SF                                                                                    | ⊗  | ⊗          | ⊗        | ⊗      |     |       |       |                  | ⊗   |     |        |     | U         |
|             | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>100cm</b>                      |  EP100-SF | ⊗  | ⊗          |          |        |     |       |       |                  | ⊗   |     |        |     | U         |
|             | Lunette nasale Luer Lock en longueur de tube <b>130cm</b>                      | LD130                                                                                      | ⊗  | ⊗          |          |        |     |       |       |                  | ⊗   |     |        |     | U         |
|             | Lunette <b>Bucco-nasale</b> Luer Lock - longueur de <b>60cm</b>                | NC-007                                                                                     |    |            | ⊗        | ⊗      |     |       |       |                  |     |     |        |     | U         |
|             | Lunette <b>Bucco-nasale</b> Luer Lock en longueur de tube <b>180cm</b>         | NC-017                                                                                     |    |            |          |        |     |       |       |                  |     |     |        |     | U         |
|             | Lunette nasale <b>THERMOCAN</b> Luer Lock en longueur de tube <b>60cm</b>      | 15807-2                                                                                    |    |            | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗                |     | ⊗   |        | ⊗   | U         |

# CONSOMMABLES & ACCESSOIRES RESPIRATOIRE

| Désignation Produit                                                      | Référence | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |              | Cdt |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|--------------|-----|
|                                                                          |           | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno<br>PSG |     |
| Ligne de pression <b>PPC</b> Luer Lock et raccord masque en <b>60cm</b>  | EP-CPAP   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Ligne de pression <b>PPC</b> Luer Lock et raccord masque en <b>200cm</b> | EP-CPAP-L |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Raccord triconique PPC                                                   | PR03      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Filtre pour ligne de pression <b>PPC</b>                                 | 7072097   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Filtre hydrophobe 2μ                                                     | FLT       |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Raccord/Rallonge Filtre hydrophobe                                       | RAC.FLT   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Adaptateur Pressure Diff.                                                | 930322    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Adaptateur tuyaux pour Adaptateur Pressure Diff                          | WM95263   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Ensemble tuyaux double pour Adap. Pressure Diff                          | WM96503   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Ligne de contrôle de Pression <b>SOUS PPC</b> en 150cm – M/F             | 8722960   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermistance</b> Pédiatrique 90cm                                     | 7073861   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermistance</b> Adulte 90cm                                          | 7073860   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Adaptateur connectique Key Hole en double connectique 1.5mm              | 7074083   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Câble d'interface <b>THERMOCAN</b> Pédiatrique 200cm – Key Hole          | 7074981   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Câble d'interface <b>THERMOCAN</b> 90cm – Connectique Key Hole           | 7075073   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermocouple</b>                                                      | PR08      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermistance</b>                                                      | 200-0861  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermistance</b>                                                      | 929320    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Thermistance</b>                                                      | 930320    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Câble d'interface <b>THERMOCAN</b> 90cm – Connectique Key Hole           | HL1477P   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Pneumotachographe</b> avec capteur de pression différentielle         | 7073482   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Filtre pour Pneumotachographe                                            | 7073746   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Capteur de pression différentielle                                       | 7073740   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Embout connecteur droit transparent                                      | 7073744   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Embout adaptateur droit vert                                             | 7073743   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Câble adaptateur pour Pneumotachographe                                  | 7073742   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Câble adaptateur pour Pneumotachographe                                  | 7073745   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Extension de câble adaptateur pour Pneumotachographe                     | 7073741   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Pneumotachographe</b> de Fleisch (Livré avec 2 bagues 6RL206D)        | FLE1206D  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| Bague pour Pneumotachographe                                             | 6RL206D   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Pneumotachographe</b> – Module sans fil                               | PR05      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |
| <b>Pneumotachographe</b>                                                 | TOS201    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |              | U   |

# SANGLES THORACIQUES & ABDOMINALES

|                          |                                                            | POLYGRAPHE |    |     |          |        |     |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |     |        |              |          |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-----------------|-----|-----|--------|--------------|----------|---|
| Désignation Produit      |                                                            | Référence  | T3 | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno           | A1S | Lxe | Sonata | Somno<br>PSG | Cdt      |   |
| Adulte et/ou Pédiatrique | Sangle à usage unique - <b>Pédiatrique</b>                 | 7072086    |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              | Lot de 2 |   |
|                          | Sangle à usage unique - Taille <b>S</b>                    | 7072077    |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              | Lot de 2 |   |
|                          | Sangle à usage unique - Taille <b>M</b>                    | 7072078    |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              | Lot de 2 |   |
|                          | Sangle à usage unique - Taille <b>L</b>                    | 7072079    |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              | Lot de 2 |   |
|                          | Sangle à usage unique - Taille <b>XL</b>                   | 7073504    |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              | Lot de 2 |   |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>40-55CM</b>                   | SI203-36   |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>50-65CM</b>                   | SI203-45   |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>65-80CM</b>                   | SI203-55   |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>80-100CM</b>                  | SI203-70   |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>100-110CM</b>                 | SI203-90   |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>110-130CM</b>                 | SI203-110  |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>130-190CM</b>                 | SI203-130  |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle thoraco-abdominale <b>150-230CM</b>                 | SI203-150  |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>XXXS</b>            | 925287     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominal - Taille <b>XXXS</b>             | 925398     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>XXS</b>             | 925286     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominal - Taille <b>XXS</b>              | 925397     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>XS</b>              | 925285     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominal - Taille <b>XS</b>               | 925393     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique/Abdominal - Taille <b>xxxs</b>  | 930268     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique/Abdominal - Taille <b>XXS</b>   | 930267     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique/Abdominal - Taille <b>XS</b>    | 930266     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>S</b>               | 926281     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominale - Taille <b>S</b>               | 925388     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>M</b>               | 926280     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominale - Taille <b>M</b>               | 925389     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique - Taille <b>L</b>               | 926282     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Abdominale - Taille <b>L</b>               | 925390     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique & Abdominale - Taille <b>S</b>  | 930260     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique & Abdominale - Taille <b>M</b>  | 930261     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique & Abdominale - Taille <b>L</b>  | 930262     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |
|                          | Sangle d'effort Thoracique & Abdominale - Taille <b>XL</b> | 930269     |    |     |          |        |     |       |       |                 |     |     |        |              |          | U |

## SANGLES THORACIQUES & ABDOMINALES

|                          |                                                   | POLYGRAPHE |    |     |          |        |     |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |     |        |              |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|----|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-----------------|-----|-----|--------|--------------|----------|
| Désignation Produit      |                                                   | Référence  | T3 | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno           | A1S | Lxe | Sonata | Somno<br>PSG | Cdt      |
| Adulte et/ou Pédiatrique | Sangle abdominale Réutilisable - Taille XS        | TOS799     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle thoracique Réutilisable - Taille XS        | TOS804     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle abdominale Réutilisable - Taille S         | TOS800     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle abdominale Réutilisable - Taille M         | TOS801     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle abdominale Réutilisable - Taille L         | TOS802     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle abdominale Réutilisable - Taille XXL       | TOS803     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle thoracique Réutilisable - Taille S         | TOS805     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle thoracique Réutilisable - Taille M         | TOS806     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle thoracique Réutilisable - Taille L         | TOS807     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle thoracique Réutilisable - Taille XXL       | TOS808     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | U        |
|                          | Sangle par inductance à usage unique - Taille S   | SEN680     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | Lot de 4 |
|                          | Sangle par inductance à usage unique - Taille M   | SEN681     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | Lot de 4 |
|                          | Sangle par inductance à usage unique - Taille L   | SEN682     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | Lot de 4 |
|                          | Sangle par inductance à usage unique - Taille XXL | SEN683     | ⊗  | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗   | ⊗      |              | Lot de 4 |

# OXYMETRIE

| Désignation Produit                                                  | Référence  | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|------|
|                                                                      |            | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |      |
| Oxymontre NONIN 3150 BLE fourni avec son capteur SpO2                | 7078989    | ⊗          |     | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Pédiatrique Taille S                      | 8000SS-WO2 |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Adulte Taille M                           | 8000SM-WO2 |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Adulte Taille L                           | 8000SL-WO2 |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur <b>Flexible</b> Nouveau-Né < 2kg <b>Réutilisable</b>         | 8001J      |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Adhésif Flexi Wrap Nouveau-Né - Pied                                 | 8001JFW    |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 25 U |
| Capteur <b>Flexible</b> Enfant 2 à 20 kg <b>Réutilisable</b>         | 8008J      |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Adhésif Flexi Wrap Enfant – Orteil                                   | 8008JFW    |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 25 U |
| Capteur <b>Flexible</b> Adulte > 20kg <b>Réutilisable</b>            | 8000J      |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Adhésif Flexi Wrap Adulte - Doigt                                    | 8000JFW    |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 25 U |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Nouveau-Né < 2 kg à <b>Usage Unique</b>     | 6000CN     |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 24 U |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Pédiatrique 2 à 20 kg à <b>Usage Unique</b> | 6000CI     |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 24 U |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Enfant > 10 kg à <b>Usage Unique</b>        | 6000CP     |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 24 U |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Adulte > 30 Kg à <b>Usage Unique</b>        | 6000CA     |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | 24 U |
| Adaptateur pour connexion capteur <b>Flexiwrap</b> à NONIN 3150      | 7704-001   |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Extension en 1ml <b>Flexible/Flexiwrap</b> - Connexion à 7704-001    | 6083-001   |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>type Pince</b> - Taille Adulte                       | OX01       |            |     |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Pédiatrique Taille S                      | OH01       | ⊗          | ⊗   | ⊗        |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Adulte Taille M                           | OH02       | ⊗          | ⊗   | ⊗        |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 <b>Souple</b> Adulte Taille L                           | OH03       | ⊗          | ⊗   | ⊗        |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur <b>Flexible</b> Adulte > 20kg <b>Réutilisable</b>            | OH04       | ⊗          | ⊗   | ⊗        |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Adhésif Flexi Wrap Adulte - Doigt                                    | OH05       | ⊗          | ⊗   | ⊗        |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | 12 U |
| Capteur SpO2 Pédiatrique 1-4 kg                                      | 920126     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 Enfant 4-40 kg                                          | 920127     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Câble adaptateur pour Capteur SpO2 1 à 40 Kg                         | 200-0370   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Câble adaptateur pour Capteur SpO2 1 à 40 Kg                         | 920123     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 Adulte                                                  | 200-0310   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 Adulte                                                  | 930300     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur SpO2 Pédiatrique                                             | TOS062     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |
| Capteur SpO2 Adulte Taille M                                         | TOS064     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |
| Capteur SpO2 Adulte Taille L                                         | TOS060     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |

## CONSOMMABLES & ACCESSOIRES D'EQUIPEMENT

[illegible]

# CONSOMMABLES & ACCESSOIRES D'EQUIPEMENT

| Désignation Produit                                          | Référence   | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|------|
|                                                              |             | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |      |
| Capteur pression pneumatique Thoracique - <b>Pédiatrique</b> | 929150      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Abdominale - <b>Pédiatrique</b> | 925396      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Thoracique - <b>Pédiatrique</b> | 930395      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Abdominale - <b>Pédiatrique</b> | 930395      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Thoracique                      | 929140      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Abdominale                      | 925395      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Thoracique                      | 930393      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur pression pneumatique Abdominale                      | 930394      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur jambier avec câble 27cm                              | 200-0653/01 | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Microphone trachéal Piezzo (existe en 2.00ml)                | 930321      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur de position externe                                  | 930310      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Actimètre blanc – 2m                                         | 930407      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Pansements fixation du microphone trachéal                   | 160-0308/02 | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | 50 U |
| Skinfix fixation des câbles d'électrodes                     | WF2703/50   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | 50 U |
| Câble USB                                                    | 200-0936    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Câble USB                                                    | 930224      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Chargeur secteur                                             | 200-0910    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Chargeur secteur                                             | 930209      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Malette de transport Polygraphe                              | 200-0813    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Malette de transport Polysomnographie                        | 927304      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Etui en bandoulière                                          | 200-0812    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Etui patient Samoa                                           | 929302      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Sac de transport patient                                     | WM94055     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Sac de transport patient                                     | 930253      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Batterie seule Samoa                                         | 929180      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Chargeur de batterie externe Samoa                           | 929181      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Capot pour le compartiment batterie Samoa                    | 929124      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Batterie seule Scala/Sonata                                  | 930180      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capot pour le compartiment batterie Scala/Sonata             | 930142      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Socle de recharge batterie                                   | 930204      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Support de montage Samoa                                     | 929250      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Support de montage Scala/Sonata                              | 930250      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   |       | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Sangle velcro poignet                                        | 200-0311    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      |     |       |       | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Capteur d'effort abdominale                                  | TOS020      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |
| Capteur d'effort pour sangle à inductance 2 Voies            | TOS080      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |
| Malette de transport                                         | SOW080      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |
| Station d'accueil Somnotouch RESP.                           | TOS902      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     |       | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U    |

## CÂBLES

| Désignation Produit                                                               | Référence | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|-----|
|                                                                                   |           | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |     |
| Câble bouton pression <b>vert</b> - Connectique 1.5mm - <b>Masse</b>              | 7073446   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>orange</b> - Connectique 1.5mm - <b>ECG</b>       | 7073510   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>gris</b> - Connectique 1.5mm - <b>JAMBIER</b>     | 7073507   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>noir</b> - Connectique 1.5mm - <b>JAMBIER</b>     | 7073472   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>orange</b> - Connectique Key Hole - <b>ECG</b>    | 7072172   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>gris</b> - Connectique Key Hole - <b>JAMBIER</b>  | 7073438   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble double bouton pression <b>noir</b> - Connectique Key Hole - <b>JAMBIER</b>  | 7073439   |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 3 pressions : <b>noir</b> / <b>vert</b> / <b>rouge</b>                     | EX03      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 3 cupules : <b>noir</b> / <b>vert</b> / <b>rouge</b>                       | EX04      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 1 pression 2 cupules : <b>rouge</b> (pression), <b>vert-noir</b> (cupule)  | EX05      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2 pressions 1 cupule : <b>noir</b> (cupule), <b>vert-rouge</b> (pression)  | EX06      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2x2 pressions pour jambier : <b>vert</b> / <b>rouge</b>                    | EX07      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 4 cupules : <b>noir</b> (x2) / <b>vert</b> / <b>rouge</b>                  | EX08      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2 pression 2 cupule : <b>noir</b> (cupules), <b>vert-rouge</b> (pressions) | EX09      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2 pression 2 cupule : <b>noir</b> (pressions), <b>vert-rouge</b> (cupules) | EX10      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 4 pressions : <b>noir</b> (x2) / <b>vert</b> / <b>rouge</b>                | EX11      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2 pressions pour ECG : <b>vert</b> / <b>rouge</b>                          | EX12      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 1 pression : <b>noir</b>                                                   | EX15      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Cordon 2 cupule : <b>vert-rouge</b>                                               | EX20      |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Adaptateur pour Câble ECG/EMG                                                     | 200-0858  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble ECG à 3 brins d'électrodes <b>rouge/ Vert/ Noir</b>                         | 200-0850  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble rallonge 2 connecteurs pour jambier                                         | 930410    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble neuroport EEG                                                               | 200-0951  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble d'électrodes 80cm – <b>Rouge</b> – idéal ECG                                | 930411    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble d'électrodes 80cm – <b>Vert</b> – idéal ECG                                 | 930412    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble d'électrodes 150cm – <b>Rouge</b> – idéal EMG Jambier                       | 930416    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble d'électrodes 150cm – <b>Vert</b> – idéal EMG Jambier                        | 930417    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |
| Câble connexion électrodes à pression (10 couleurs)                               | SEN018    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | U   |

## CONSOMMABLES & ACCESSOIRES DE NEUROLOGIE

| Désignation Produit                                                    | Référence | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|-----|
|                                                                        |           | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |     |
| Tresse EEG - <b>Pédiatrique</b>                                        | 7073442   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Tresse EEG                                                             | 7073514   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Extension Tresse EEG avec 5 cupules OR                                 | 7073441   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Tresse EEG <b>Nox SAS Nouveauté</b>                                    | 70710079  | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Extension Tresse EEG côté gauche <b>NOX SAS Nouveauté</b>              | 70710078  | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Extension Tresse EEG côté droit <b>NOX SAS Nouveauté</b>               | 70710077  | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Tête - Boîtier de connexion d'électrodes                               | EX01      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               |     | ⊗      | ⊗         | U   |
| Boîtier de connexions d'électrodes                                     | EX14      | ⊗          | ⊗   |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Boîtier de connexions d'électrodes – <b>Montage HypnoLight</b>         | EX27      | ⊗          | ⊗   |          | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U   |
| Tête - Neuro Module                                                    | 930020    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U   |
| Câble de connexion Sonata/tête - Fil court – 9cm                       | 930220    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U   |
| Câble de connexion Sonata/tête - Fil long – 60cm                       | 930221    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U   |
| Support de montage Tête                                                | 930251    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U   |
| Support de montage en « V » Tête/Sonata                                | 930252    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | U   |
| Tête <b>AASM seule</b>                                                 | TOS094    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |
| Tête <b>R&amp;K seule</b>                                              | TOS096    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |
| Capteur effort + 2 voies PLM                                           | TOS170    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |
| Capteur effort + 2 voies PLM + 1 voie ECG                              | TOS175    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |
| Kit Polysomnographie (TOS094+TOS175+SEN018) – <b>Pose à électrodes</b> | 110315    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |
| Kit Polysomnographie (TOS094+TOS175+EP100CUP) – <b>Pose à cupules</b>  | 110316    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | U   |

## ELECTRODES

| Désignation Produit                                                              | Référence   | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|------|
|                                                                                  |             | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |      |
| Electrodes <b>cupules OR</b> - 5 couleurs / 10 fils – <b>idéal pour EEG</b>      | EP100CUP    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Electrodes <b>cupules OR</b> - 2 couleurs/3 fils – <b>idéal pour Mentonnier</b>  | EP30CUP     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Electrodes <b>cupules OR</b> - 1.00ml – à l'unité ( <i>préciser la couleur</i> ) | EP1CUP      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   |        | ⊗         | U    |
| Electrodes jetable <b>EEG</b> bouton pression                                    | 7072171-M   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | 50 U |
| Kit d'électrodes <b>Nox SAS Nouveauté</b>                                        | 70710076    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | U    |
| Electrodes jetables <b>EMG mentonnier</b> avec câble 50cm                        | 7073775-K   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   | ⊗      | ⊗         | 12 U |
| Electrodes jetable <b>ECG</b> bouton pression ( <i>identique pour la masse</i> ) | 7075209-R   | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   |        | ⊗         | 25 U |
| Electrodes jetable <b>PLM jambier</b> bouton pression                            | 631526-N    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 | ⊗   |        | ⊗         | 25 U |
| Electrodes pré-gélifiées pour fils pression - <b>Adulte</b>                      | COMP500     | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               |     | ⊗      | ⊗         | 50 U |
| Electrodes pré-gélifiées pour fils pression - <b>Pédiatrique</b>                 | COMP-PED600 | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               |     | ⊗      | ⊗         | 60 U |
| Electrodes <b>EMG mentonnier/jambier*</b> avec câble 1.00ml                      | 72010K      | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   |        | ⊗         | 10 U |
| Electrodes <b>ECG-PLM</b> adhésives                                              | SEN012A     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | 30 U |
| Electrodes <b>EOG-EEG</b> adhésives                                              | SEN010C     | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     | ⊗               | ⊗   | ⊗      |           | 30 U |

# AUTRES CONSOMMABLES & ACCESSOIRES D'ENREGISTREMENT

| Désignation Produit                                                          | Référence | POLYGRAPHE |     |          |        |     |       |       |       | POLYSOMNOGRAPHE |     |        |           | Cdt  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----------|------|
|                                                                              |           | T3         | T3S | Lx / Lxa | Hypnea | Ms+ | Scala | Samoa | Somno | A1S             | Lxe | Sonata | Somno PSG |      |
| Crème abrasive NUPREP préparation de la peau – Tube de 114g                  | NUP       | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Gel abrasive EVERI préparation de la peau – Flacon de 160g                   | EVER      | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Pâte TEN20 conductrice – Pot de 114g                                         | TEN20     | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Pâte AC CREAM conductrice – Pot de 250g                                      | AC CREAM  | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Crème LIC2 auto-adhésive longue durée – Tube de 100g                         | LIC2      | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Crème SAC2 auto-adhésive longue durée – Tube de 100g                         | SAC2      | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | U    |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Doigt – Taille 1                        | 187-2216  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Poignet/Cheville – Taille 2             | 187-2217  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Bras/Jambe – Taille 3                   | 187-2218  |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Jambe – Taille 5                        | 187-2219  | ⊗          | ⊗   |          |        |     |       | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Tête/Thorax – Taille 6                  | 187-2220  | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Thorax/Bassin/Epaule – Taille 7         | 187-2221  | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix - Filet tubulaire élastique Thorax – Taille 10                      | 187-2224  | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix ZéroLatex - Filet tubulaire élastique - Poignet/Cheville - Taille B | 135441    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix ZéroLatex - Filet tubulaire élastique - Bras/Jambe - Taille D       | 135443    |            |     |          |        |     |       |       |       |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix ZéroLatex - Filet tubulaire élastique - Jambe - Taille E            | 135444    | ⊗          | ⊗   |          |        |     |       | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix ZéroLatex - Filet tubulaire élastique Tête - Taille F               | 135445    | ⊗          | ⊗   |          |        | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |
| Surgifix ZéroLatex - Filet tubulaire élastique - Thorax/Taille – Taille G    | 135446    | ⊗          | ⊗   | ⊗        | ⊗      | ⊗   | ⊗     | ⊗     | ⊗     |                 |     |        |           | 25ml |

# CHAMBRE DU SOMMEIL


| Equipement                                                                          | Fournisseur             | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    | RESMED                  | NOX A1S   |
|    | LOWENSTEIN              | SONATA    |
|    | CIDELEC                 | CID Lxr   |
|    | SEFAM                   | SOMNO HD  |
|   | Lit + Sommier + Matelas | EP-L      |
|  | Fauteuil                | EP-F      |

# CHAMBRE DU SOMMEIL MOBILE

| Equipement                                                                        | Fournisseur                                           | Référence | Composition                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>Compatible</u></p> <p>ResMed<br/>Lowenstein</p> | MAX540    | <p><i>Composition :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinateur portable</li> <li>• Switch RJ45</li> <li>• Caméra</li> <li>• Boîtier de communication</li> <li>• Kit PSG &amp; Consommables</li> <li>• Câbles</li> </ul> |

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))


| Code    | Intitulé CCAM                                                                                        | Arbre          |     | Actif        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|
| AMQP015 | <i>Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                 | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/01/2025 → |
| AMQP015 | <i>Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                 | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/07/2025 → |
| AMQP013 | <i>Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                  | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/01/2025 → |
| AMQP013 | <i>Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                  | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/07/2025 → |
| AMQP011 | <i>Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                   | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/01/2025 → |
| AMQP011 | <i>Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo</i>                                   | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/07/2025 → |
| AMQP009 | <i>Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives (TILE – TME)</i> | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/01/2025 → |
| AMQP009 | <i>Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives (TILE – TME)</i> | <u>1.1.1.6</u> |     | 01/07/2025 → |
| Code    | Intitulé CCAM                                                                                        | GHS            | DA  | Actif        |
| 23K02Z  | <i>Exploration nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours : PUBLIC</i>                   | 7959           | D26 | 2022 →       |
| 23K02Z  | <i>Exploration nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours : PUBLIC</i>                   | 5864           | D26 | 2022 →       |
| 23K02Z  | <i>Exploration nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours : PRIVEE</i>                   | 7959           | D26 | 2022 →       |
| 23K02Z  | <i>Exploration nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours : PRIVEE</i>                   | 5864           | D26 | 2022 →       |
| 23M20Z  | <i>Autres symptômes et motif de recours aux soins de la CMD 23 : PUBLIC</i>                          | 7990           | D26 | 2022 →       |
| 23M20Z  | <i>Autres symptômes et motif de recours aux soins de la CMD 23 : PRIVEE</i>                          | 7990           | D26 | 2022 →       |

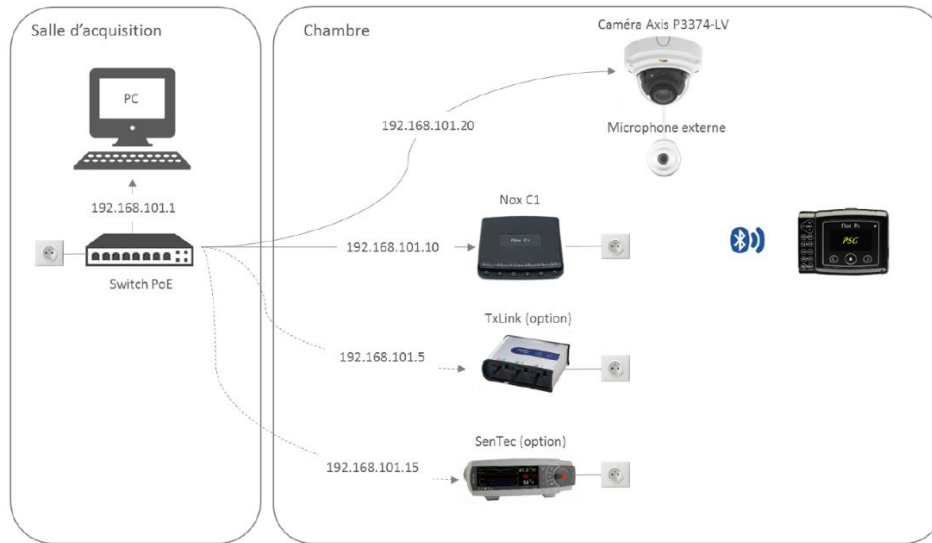

## Principe de montage

## Principe de pose

### Positionnement de la tresse et des capteurs EEG

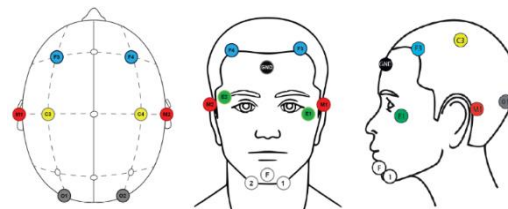

### Pose des capteurs EMG Mentonnier


7

### Pose des capteurs PLM

6

### Pose des capteurs ECG

5

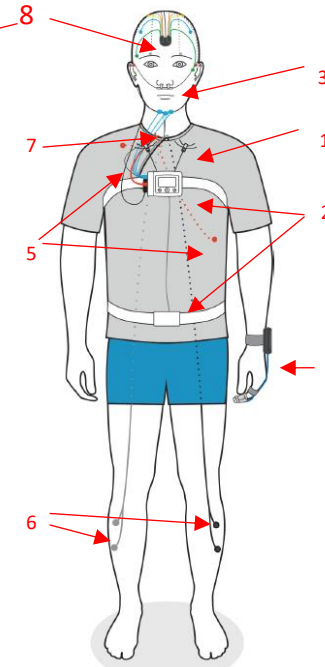

Mise en place des pinces à vêtements

1

Mise en place du polysomnographie avec le câble abdomen fixé au sangle RIP Abdo & Thorax

2

Mise en place de la canule nasale


3

Mise en place de l'oxymètre de pouls

4


| Equipement                                                                          | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|    | RESMED      | NOX A1S   | Système de polysomnographie ventilatoire                    |
|    | RESMED      | NOX C1S   | Kit boîtier de communication avec Pneumotachographe intégré |
|    | RESMED      | AXIS      | Axis vidéo caméra IP fixe avec éclairage infrarouge intégré |
|    | RESMED      | SWITCH    | Switch 8 ports dont 4 POE avec Kit de câble réseau          |
|    | RESMED      | PC        | Mini tour – Unité centrale « DELL »                         |
|    | RESMED      | ECRAN 1P  | Ecran LCD 24’’ disponible de 1 à 4 acquisitions             |
|   | RESMED      | ECRAN 4P  | Ecran LED 43’’ disponible à partir de 4 acquisitions        |
|  | RESMED      | TxLink    | Coupleur de machine de traitement Resmed                    |
|  | RESMED      | SENTEC    | Capnographe transcutanée                                    |

**Principe  
d'installation**

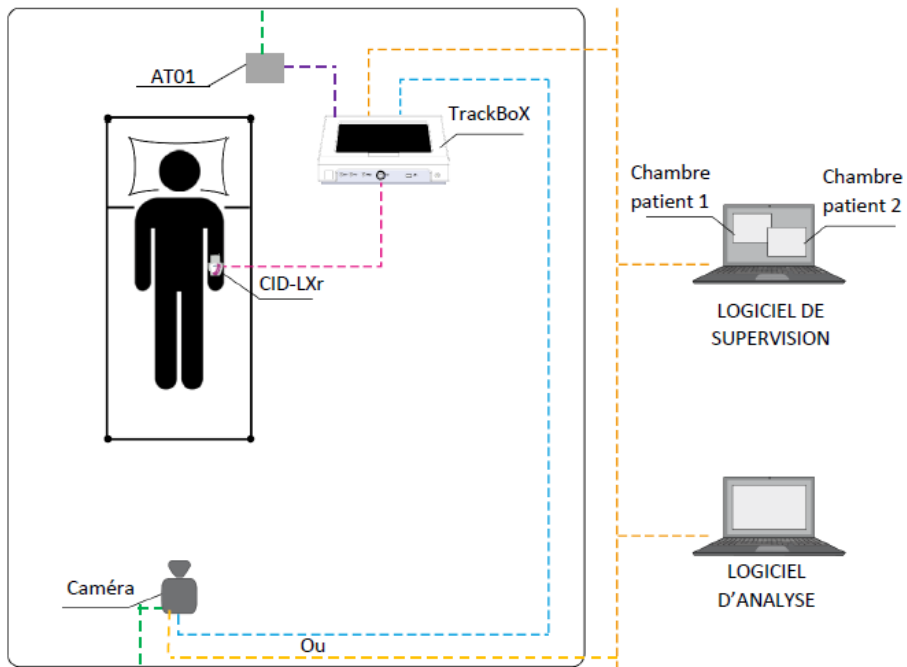

## Principe de montage

## Principe de pose

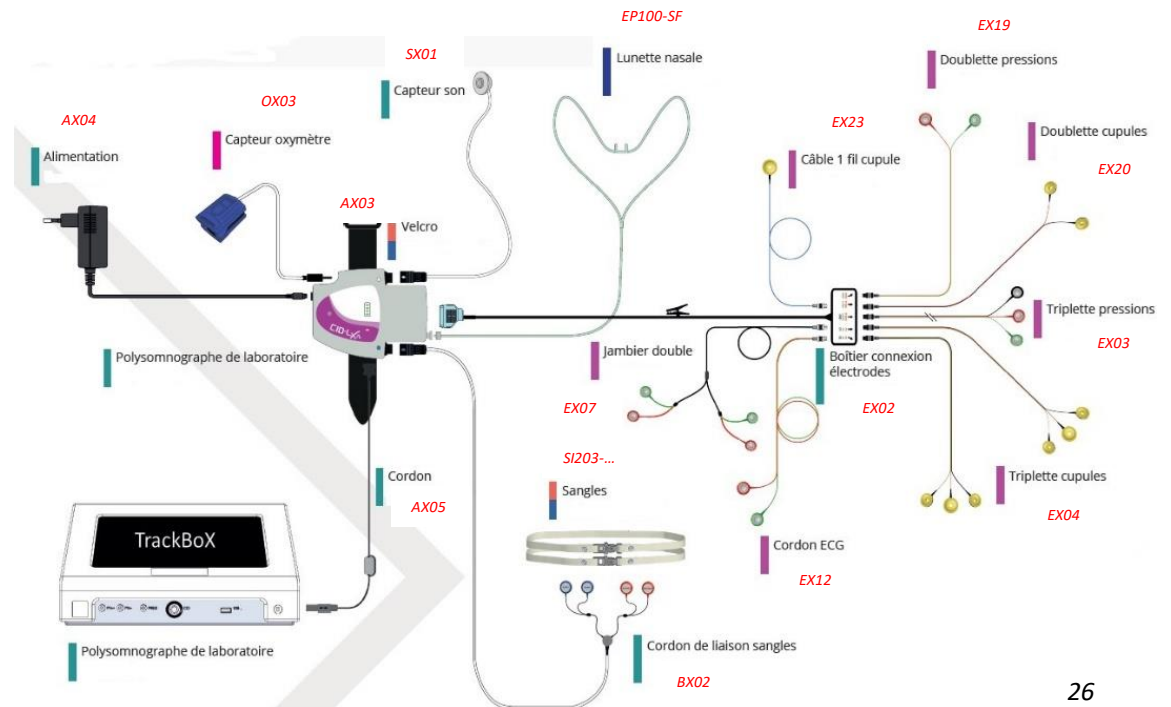


**Principe  
d'installation**

| Equipement                                                                          | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CIDELEC     | CID Lxr   | <p>La Smart-PSG-1 est un ensemble équipant la chambre du sommeil comprenant :</p> <p>Le polysomnographe installé sur le patient pour relever les signaux électrophysiologiques.</p> <p>La TrackBox pour la programmation de l'enregistrement, la visualisation en temps réel et la supervision à distance.</p> <p>Le logiciel de relecture pour l'analyse, l'archivage et les résumés personnalisables.</p> |
|    | CIDELEC     | TrackBox  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Alim.</i>                                                                        | CIDELEC     | AX05      | Cordon de connexion CID Lxr/TrackBox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Bloc</i>                                                                         | CIDELEC     | AT01      | Bloc d'alimentation TrackBox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Option Vidéo</i>                                                                 | CIDELEC     | Smart-PSG | Enregistrement et visionnage Vidéo en temps réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | CIDELEC     | PC        | Mini tour – Unité centrale « DELL »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | CIDELEC     | ECRAN 1P  | Ecran LCD 24" disponible de 1 à 4 acquisitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | CIDELEC     | ECRAN 4P  | Ecran LED 43" disponible de à partir de 4 acquisitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Principe de montage




## Principe de pose

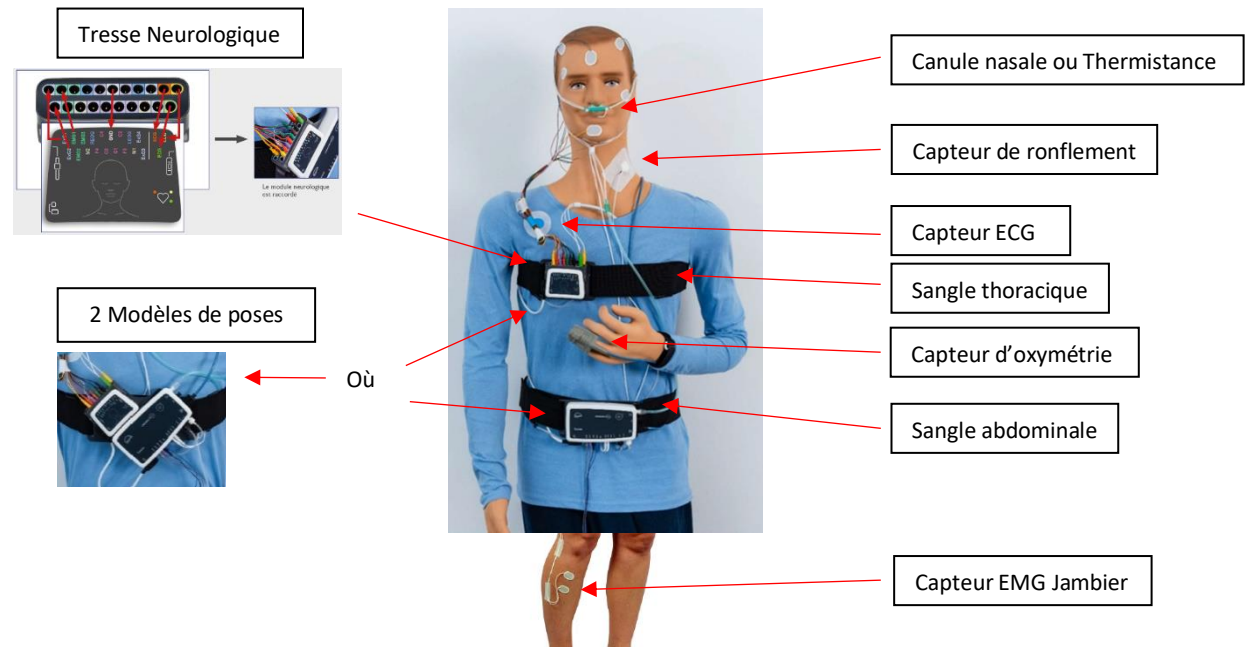

| Equipement                                                                          | Fournisseur | Référence                      | Désignation produit                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | LOWENSTEIN  | Sonata                         | Système de polysomnographie ventilatoire                                                             |
|    | LOWENSTEIN  | HL83500                        | Ensemble audio/vidéo MPGE4 comprenant :<br>- Caméra vidéo rotative<br>- Microphone<br>- Haut-parleur |
|    | LOWENSTEIN  | 1930200                        | Sonata Base avec câble réseaux inclus pour l'Online - 65 canaux de base                              |
|    | LOWENSTEIN  | LabBox<br><i>Sous thérapie</i> | LabBox avec interfaces PSG/PPC/VNDP<br>Interfaces inclus :<br>- Lowenstein<br>- Resmed<br>- Philips  |
|    | CIDELEC     | PC                             | Mini tour – Unité centrale « DELL »                                                                  |
|   | CIDELEC     | ECRAN 1P                       | Ecran LCD 24" disponible de 1 à 4 acquisitions                                                       |
|  | CIDELEC     | ECRAN 4P                       | Ecran LED 43" disponible de à partir de 4 acquisitions                                               |
| TAB.                                                                                | LOWENSTEIN  | HOSTTABLET                     | Pack tablette                                                                                        |
| WIFI                                                                                | LOWENSTEIN  | 100-0796/26                    | Point d'accès WIFI                                                                                   |


**Principe  
d'installation**

Schéma SOMNO HD/ SOMNO HD ECO avec vidéo

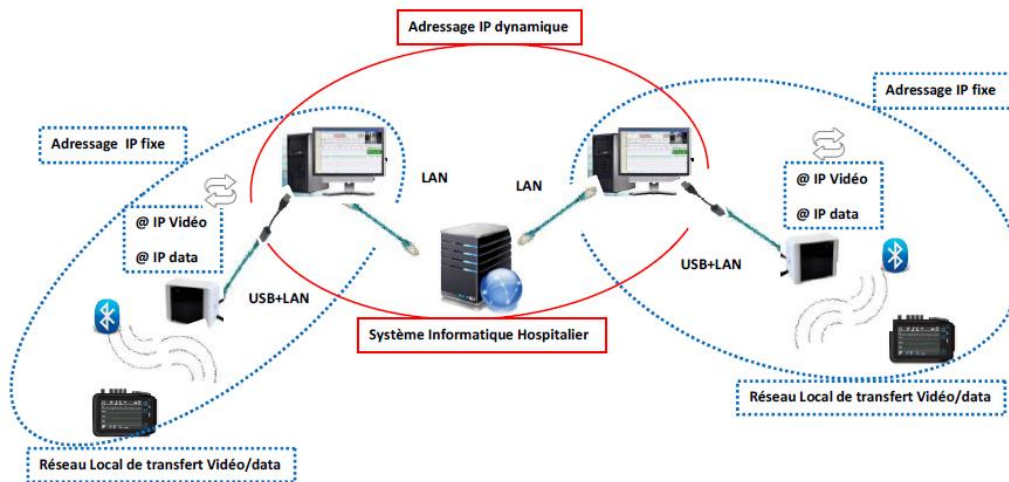

Le volume des données transférées est de l'ordre du Mega Bit. On avoisine les 50 MB pour une polygraphie et 350 MB pour une polysomnographie.

## Principe de montage

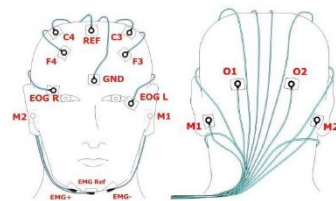

## Positionnement des capteurs EEG

Capteur ECG

Sangle thoracique

Capteur d'activité électrodermique

Sangle abdominale

Canule nasale ou Thermistance

Capteur de ronflement

Tresse Neurologique

Capteur ECG

Capteur d'oxymétrie

Capteur EMG Jambier sans fil ou filaire

## Principe de pose

| Equipement                                                                          | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SEFAM       | NGDV202A  | SOMNO HD avec caméra COMPACT<br>Polysomnographie avec transmission de données en ligne et vidéométrie numérique IR, AASM, comprenant :<br>1 Polysomnographie « SOMNO HD » 31 canaux avec écran tactile<br>1 Caméra vidéo infrarouge avec module de transmission radio intégré |
|    | SEFAM       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | SEFAM       | KOMP29    | Commutateur gigabit 8 ports <i>(existe en 16 ports &amp; 24 ports)</i>                                                                                                                                                                                                        |
|    | SEFAM       | SWITCH    | Switch 8 ports dont 4 POE                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | SEFAM       | SSC085    | Carte ADC externe 8 canaux – connecteur LAN<br><i>(Existe en prise stéréo)</i>                                                                                                                                                                                                |
|    | RESMED      | PC        | Mini tour – Unité centrale « DELL »                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | RESMED      | ECRAN 1P  | Ecran LCD 24” disponible de 1 à 4 acquisitions                                                                                                                                                                                                                                |
|    | RESMED      | ECRAN 4P  | Ecran LED 43” disponible à partir de 4 acquisitions                                                                                                                                                                                                                           |
|  | SEFAM       | NGA100    | Optocoupleur analogique 1 canal pour connexion externe                                                                                                                                                                                                                        |
|  | SEFAM       | OPT184    | Support mobile pour caméra vidéo                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | SEFAM       | OPT183    | Chariot d'équipement pour ordinateur portable                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |             | OPT185    | Chariot d'équipement pour PC                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | SEFAM       | KOMP40    | Point d'accès sans fil – Routeur pour configurer un réseau <i>WLAN</i>                                                                                                                                                                                                        |

**Principe  
d'installation**

# INDEX

---

1. ECHELLE DE EPWORTH

2. ECHELLE DE PICHOT

3. AGENDA DU SOMMEIL

4. QUESTIONNAIRE STOP-BANG

5. EVALUATION DU SOMMEIL

6. QUESTIONNAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA NUIT

7. MON AFFICHE « L'APNEE DU SOMMEIL »

8. MON AFFICHE « MON EXAMEN DE POLYGRAPHIE »

9. MON AFFICHE « MON EXAMEN DE POLYSOMNOGRAPHIE »

<https://www.expresspoly.fr/questionnaire-de-sante/>



*Je scanne et je choisis mon document !!*

# *Item 3*

## *Capnographie*

# CAPNOGRAPHIE

*ResMed*

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | RESMED      | Capnographe SENTEC |

| Désignation Produit                                 | Référence | Conditionnement |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Logiciel V'Stat                                     | 7073801   | U               |
| Capteur SENTEC V-SIGN SpO2 / pCO2 / PR              | 707231    | U               |
| Câble d'extension du capteur V-SIGN                 | 707232    | U               |
| Electrodes adhésives multisite <b>peau intact</b>   | 7079261   | Lot de 48       |
| Electrodes adhésives multisite <b>peau sensible</b> | 7079262   | Lot de 24       |
| Clip oreille                                        | 7073376   | Lot de 24       |
| Kit de remembrance pour capteur V-SIGN              | 7079264   | U               |
| Recharge pour kit de remembrance                    | 7071323   | Lot de 5        |
| Cartouche de gaz de calibration 600ml               | 707236    | U               |
| Câble USB de connexion au PC                        | 7073739   | U               |
| Sac de transport                                    | 70793     | U               |
| Gel de contact <b>5ml</b>                           | 707242    | U               |
| Gel de contact <b>10ml</b>                          | 603210    | U               |
| Compresse alcoolisées                               | 7079738   | Lot de 100      |



| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | RADIOMETER  | Capnographe TCM5 |

| Désignation Produit                                              | Référence   | Conditionnement |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Licence Logiciel Visi-Downlod Stowood                            | 290-498     | U               |
| Capteur TC-92                                                    | 5621000     | U               |
| Anneau de fixation N32 <i>fourni avec un gel de contact 10ml</i> | 5601500     | Lot de 60       |
| Clip oreille                                                     | 5601300     | U               |
| Kit de remembrance pour capteur TC-92                            | 5601100     | U               |
| Cartouche de gaz de calibration 180ml                            | 962-209     | U               |
| Flacon d'électrolyte 10ml                                        | 5601110     | U               |
| Malette de transport                                             | RDM393-CASE | U               |
| Gel de contact <b>5ml</b>                                        | 707242      | U               |
| Gel de contact <b>10ml</b>                                       | 603210      | U               |
| Compresses alcoolisées                                           | 7079738     | Lot de 100      |

<https://www.expresspoly.fr/produit/tcm5/>



# *Item 4*

## *Respiratoire*

# SPIROMETRIE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence    | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MIR         | SPIROBANK II | Spiromètre :<br>- Test de spirométrie (CVF, CV, CVI, MVV)<br><b>Test réalisé en direct sur tablette compatible avec iPad ou Android ou PC</b>                                                                                                   |
|  | MIR         | SPIRODOC DUO | Spiromètre avec <b>option Oxymétrie</b> d'enregistrement :<br>- Test de marche<br>- Test de spirométrie (CVF, CV, CVI, MVV)<br>- Test d'oxymétrie standard et d'oxymétrie nocturne<br><b>Test réalisé en direct sur l'appareil ou sur le PC</b> |

| Désignation Produit                                              | Référence | Conditionnement |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Turbine digitale "FLOWMIR" à usage unique                        | 910004    | Lot de 10       |
| Adaptateur buccal Pédiatrique "FLOWMIR" réutilisable             | 910311    | U               |
| Turbine réutilisable avec grille de protection                   | 910002    | U               |
| Embout buccal réutilisable pour turbine réutilisable             | 910307    | U               |
| Embout buccal pédiatrique réutilisable pour turbine réutilisable | 910310    | U               |
| Capteur SpO2 souple – Small – utiliser avec câble adaptateur     | 939005    | U               |
| Capteur SpO2 souple - Médium – utiliser avec câble adaptateur    | 939007    | U               |
| Capteur SpO2 souple - Large – utiliser avec câble adaptateur     | 939008    | U               |
| Câble adaptateur d'extension pour capteur SpO2 - 50cm            | 919210    | U               |
| Câble adaptateur d'extension pour capteur SpO2 - 150cm           | 919200    | U               |
| Capteur SpO2 souple – Large                                      | 919024    | U               |
| Ceinture pour Spirodoc Duo avec coquille et porte coquille       | 919088    | U               |
| Pince nez clip BLEU                                              | A508      | U               |
| Logiciel MIR version réseau (5 postes maxi)                      | 920215    | U               |
| Licence logiciel supplémentaire                                  | 920216    | U               |

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                                                                                                 | Arbre          | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|
| GLQP012 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement ( <b>spirométrie</b> standard).                                                             | <u>6.1.7.4</u> | 40,28 € | 1           | 2005 → |
| GLQP008 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle ( <b>spirométrie</b> standard avec gaz du sang).                            | <u>6.1.7.4</u> | 67,20 € | 1           | 2005 → |
| EQQP003 | Mesure de la distance de <b>marche</b> en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée.                                   | <u>6.1.7.4</u> | 28,80 € | 1           | 2005 → |
| EQQP002 | Mesure de la distance de <b>marche</b> en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile | <u>6.1.7.4</u> | 28,80 € | 1           | 2005 → |

# CABINE DE PLETHYSMOGRAPHIE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence  | Désignation produit                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|  | DUOMED      | VBODY-S    | Cabine de Pléthysmographie « Vyntus Body » sans option DLCO |
|                                                                                   | DUOMED      | VBODY-DLCO | Cabine de Pléthysmographie « Vyntus Body » avec option DLCO |

| Désignation Produit                                       | Référence | Conditionnement |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Tuyau Permapure pour diffusion                            | V-852556  | U               |
| Manomètre/Détendeur pour GAZ Vyntus                       | V-852919  | U               |
| Adaptateur pour filtre antibactérien 30mm sur pneumo 28mm | 3497-5    | U               |
| Triple V capteur de débit                                 | 707230    | U               |

| Visuel                                                                              | Désignation Produit                                              | Référence | Offre      | Conditionnement |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
|    | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez | 4020-01   | 1 à 400    | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | 401 à 800  | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | 801 à 1400 | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | + de 1400  | U               |
|    | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez | 4022-01   | 1 à 400    | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | 401 à 800  | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | 801 à 1400 | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | + de 1400  | U               |
|    | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez | 2020-01   | 1 à 400    | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | 401 à 800  | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | 801 à 1400 | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez |           | + de 1400  | U               |
|  | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez | 2022-01   | 1 à 400    | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | 401 à 800  | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | 801 à 1400 | U               |
|                                                                                     | Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>AVEC</b> pince nez |           | + de 1400  | U               |
|  | Pince nez clip BLEU                                              | A508      | 1 à 400    | U               |
|                                                                                     | Pince nez clip BLEU                                              |           | 401 à 800  | U               |
|                                                                                     | Pince nez clip BLEU                                              |           | 801 à 1400 | U               |
|                                                                                     | Pince nez clip BLEU                                              |           | + de 1400  | U               |

## Cotation – Remboursement (source : www.aideaucodage.fr)

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                                                                                    | Arbre   | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par <b>pléthysmographie</b> . | 6.1.7.4 | 76,80 € | 1           | 2005 → |
| GLQP011 | Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par <b>pléthysmographie</b> .                                                                    | 6.1.7.4 | 67,64 € | 1           | 2005 → |

# PULMONE – PLETHYSMOGRAPHIE SANS CABINE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PulmOne     | MiniBox+  | Appareil d'EFR complète avec pléthysmographie portable, sans gaz, sans cabine, incluant les tests de spirométrie, de pléthysmographie et de diffusion fourni avec un Kit d'installation (CVL, CVF, VMM, CPT, DLCO) |

| Désignation Produit                                                             | Référence   | Conditionnement |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Chariot MiniBox+                                                                | MB-CHARIOT  | U               |
| Seringue de calibration 3L                                                      | MB-SERINGUE | U               |
| Valise Cargo de transport                                                       | MB-VALISE   | U               |
| Protection de tablette souple en silicone                                       | MD-PROTECT  | U               |
| Poignée HHU                                                                     | MB-POIGNEE  | U               |
| Vanne de régulation DLCO                                                        | MB-VANNE    | U               |
| Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez – Embout Rond  | 2020-01     | U               |
| Filtre antibactérien & antiviral PulmoSafe <b>SANS</b> pince nez – Embout Ovale | 4020-01     | U               |
| Pince nez clip BLEU                                                             | A508        | U               |


## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                                                                                    | Arbre                   | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|--------|
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par <b>pléthysmographie</b> . | <a href="#">6.1.7.4</a> | 76,80 € | 1           | 2005 → |
| GLQP011 | Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par <b>pléthysmographie</b> .                                                                    | <a href="#">6.1.7.4</a> | 67,64 € | 1           | 2005 → |

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence  | Désignation produit                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LEMON       | F09G100171 | Le Vivatmo Pro est conçu pour mesurer la concentration de l'oxyde nitrique (NO) dans l'air expiré et pour surveiller l'inflammation allergique des voies respiratoires chez les patients. |

| Désignation Produit      | Référence  | Conditionnement | Tarif TTC |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Filtres Vivatmo pro FeNO | F09G100152 | Lot de 50       | 372,84 €  |



INTERPRETATION DES RESULTATS

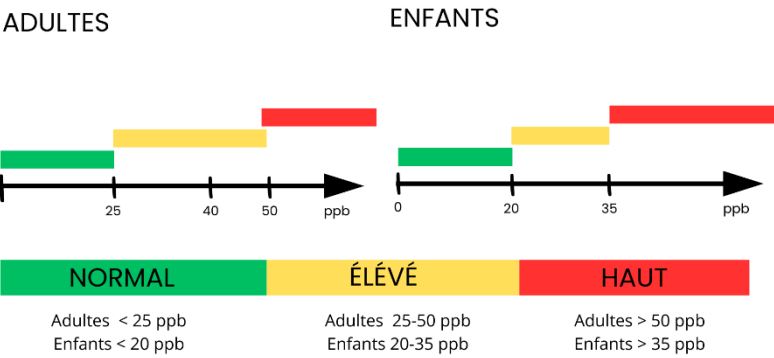


|                                              | NORMAL                                                                                                                                                                                                                        | ÉLEVÉ                                                                                                                                                                                   | HAUT                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FENO                                         | Adultes < 25 ppb<br>Enfants < 20 ppb                                                                                                                                                                                          | Adultes 25-50 ppb<br>Enfants 20-35 ppb                                                                                                                                                  | Adultes > 50 ppb<br>Enfants > 35 ppb                                                                                                                                                                            |
|                                              | DIAGNOSTIC                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Symptômes présents depuis plus de 6 semaines | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inflation éosinophile des voies respiratoires improbable</li><li>• Diagnostic alternatif</li><li>• Peu susceptibles de bénéficier d'une ICS (Corticostéroïde en inhalation)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soyez prudent</li><li>• Se faire évaluer dans une clinique</li><li>• Faites des tests régulièrement du FENO</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inflation éosinophile des voies respiratoires</li><li>• Probabilité élevée d'une présence d'une ICS (Corticostéroïde en inhalation)</li></ul>                           |
|                                              | Surveillance (chez les patients dont l'asthme a été diagnostiqué)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Symptômes présents                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autres diagnostics possibles</li><li>• Peu susceptibles de bénéficier d'une augmentation des ICS</li></ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Exposition persistante aux allergènes</li><li>• Dose de CSI inadéquate</li><li>• Mauvais traitement</li><li>• Résistant aux stéroïdes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Exposition persistante aux allergènes</li><li>• Dose de CSI inadéquate</li><li>• Mauvais traitement ou mauvaise inspiration</li><li>• Résistant aux stéroïdes</li></ul> |
| Symptômes absents                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonne dose d'ICS</li><li>• Bon traitement</li><li>• Diminution des ICS</li></ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonne dose d'ICS</li><li>• Bon traitement</li><li>• Faites des tests</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le servage des ICS ou la réduction de la dose peut entraîner une rechute.</li><li>• Mauvais traitement ou mauvaise inspiration</li></ul>                                |

# PEAKFLOW

| Equipement                                                                       | Fournisseur                                                                                      | Référence                        | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>EXPRESSPOLY | <i>Nouveauté</i><br><br>PEAKFLOW | <p>Le débitmètre de pointe est un appareil portable qui mesure le débit d'air, ou débit expiratoire de pointe.</p> <p>Déterminer la gravité de l'asthme.</p> <p>Surveiller la réponse au traitement lors d'un épisode aigu d'asthme.</p> <p>Surveiller les progrès du traitement de l'asthme chronique et fournir des informations sur les changements de thérapie.</p> <p>Détecter une détérioration de la fonction pulmonaire et éviter une éventuelle crise d'asthme sévère.</p> |

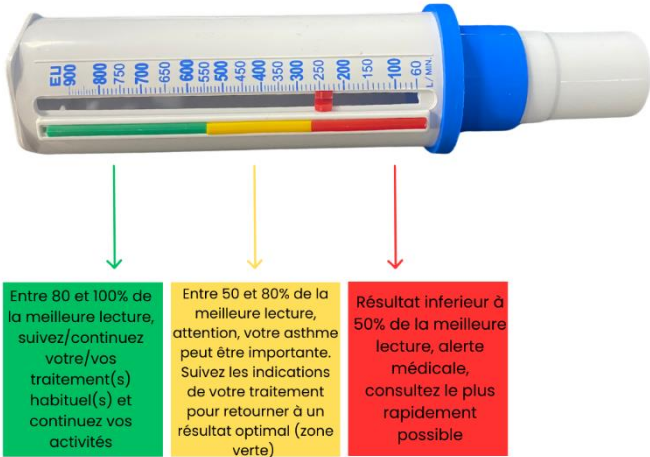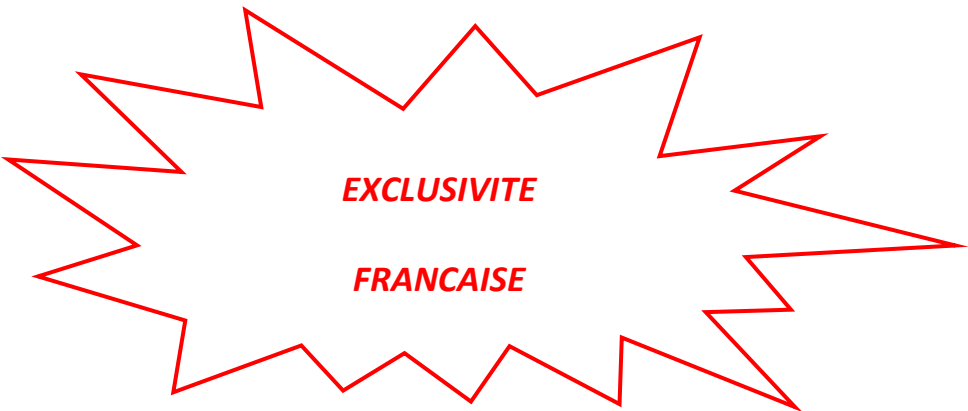

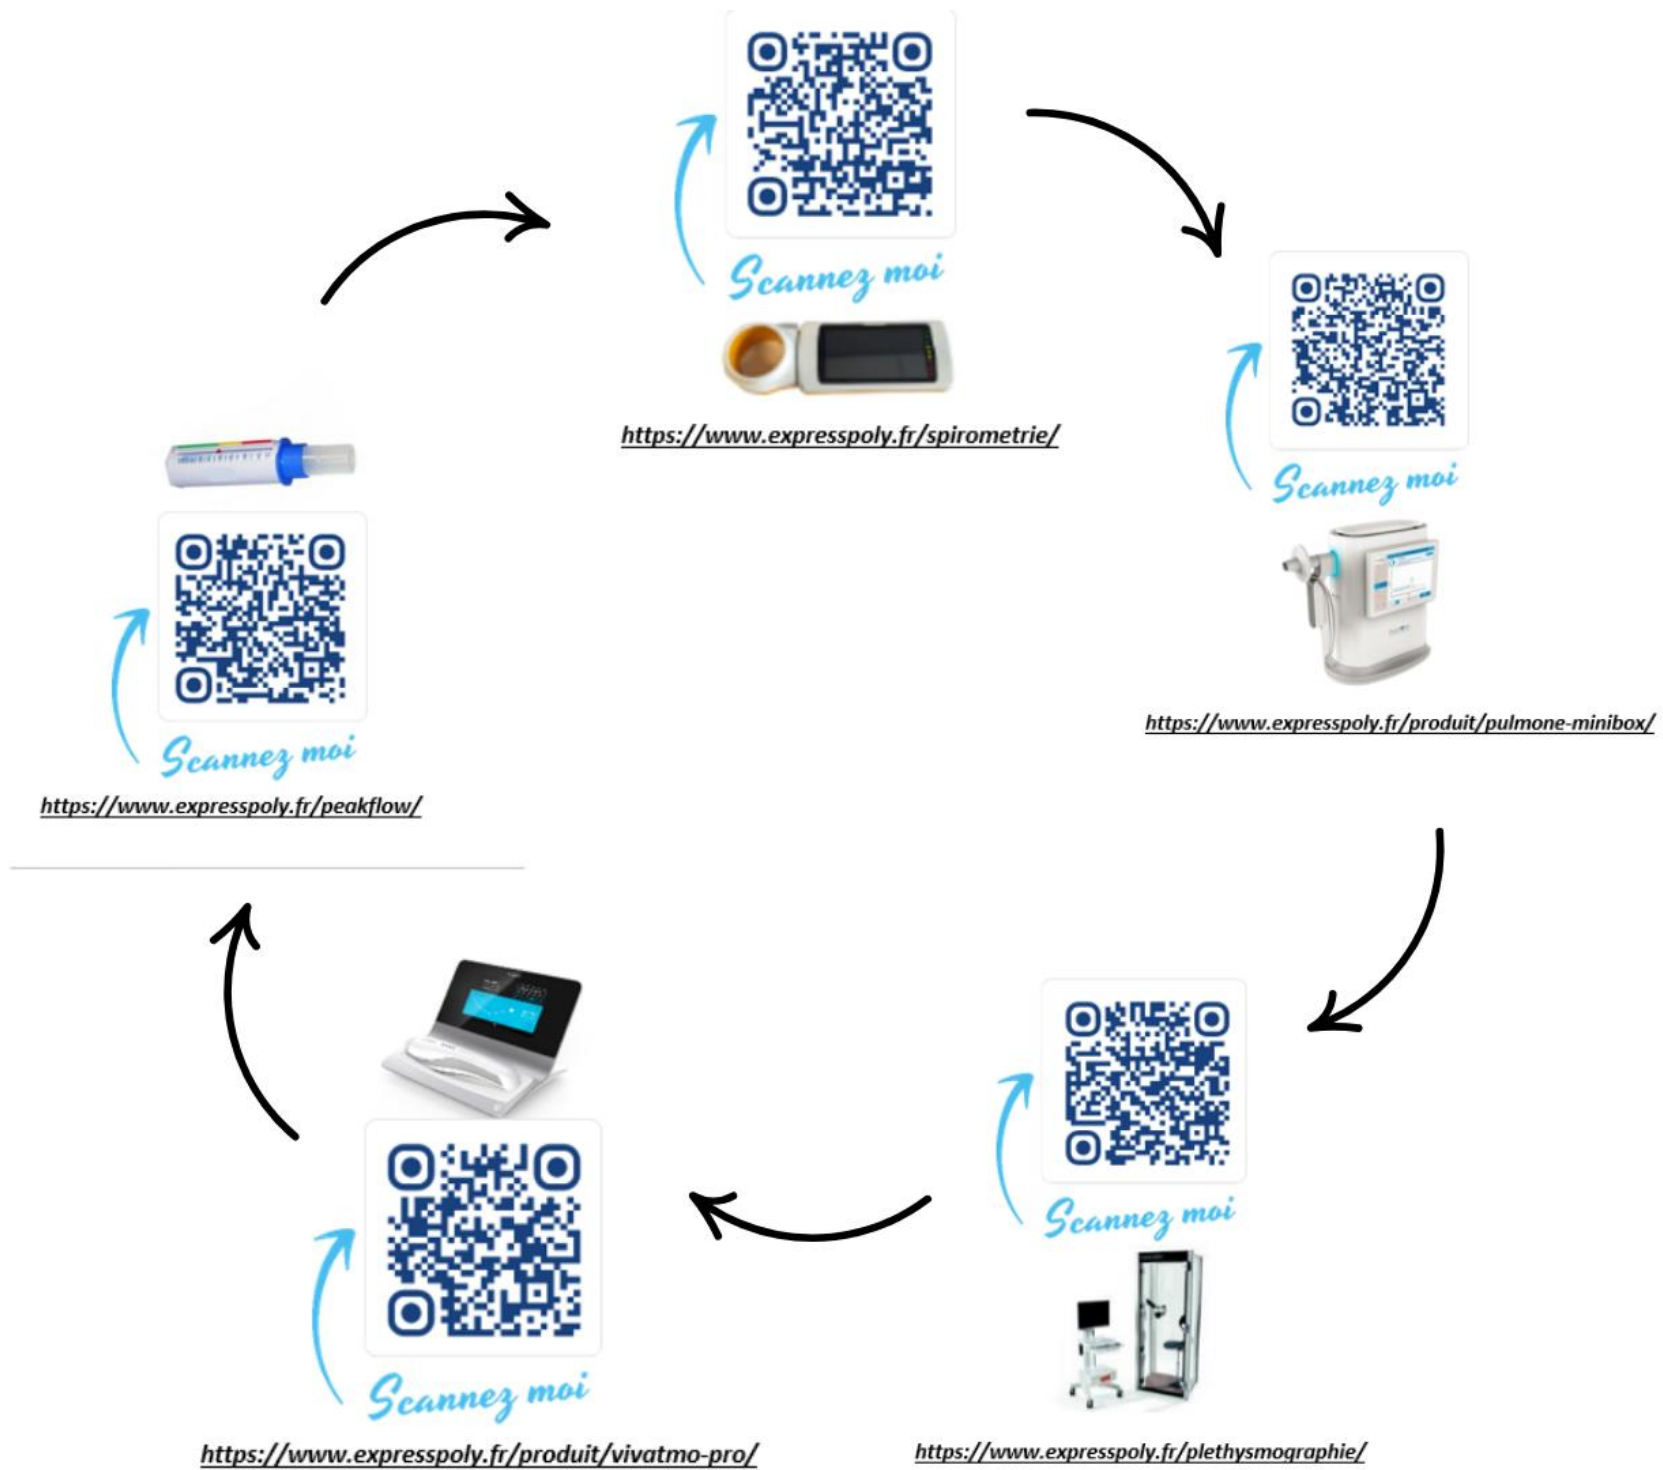

# *Item 5*

## *VO2 Test d'effort*

# VO2 TEST D'EFFORT

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence    | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DUOMED      | V-178003     | « VYNTUS CPX » avec Chariot ITD comprenant :<br>- PC mini tour<br>- Imprimante Laser<br>- Licence interface<br>- Ecran panoramique 34 pouces<br>- Kit gaz détendeur + Bouteille 0.8 L<br>- Kit mesure de saturation O2<br>- ECG d'effort 12D avec câble patient |
|  | DUOMED      | V-6001       | Vélo d'effort avec selle électrique et PNI                                                                                                                                                                                                                      |
|  | DUOMED      | V-6004       | Tapis de course XRCise RUNNER MED                                                                                                                                                                                                                               |
|  | DUOMED      | CN-1-2-4-132 | Module de VO2 pour vyntus CPX avec système d'ECG par électrodes                                                                                                                                                                                                 |
|  | DUOMED      | QND3-1       | Système d'aspiration ECG QUICKELS DECAPSUS III avec bras articulé                                                                                                                                                                                               |

| Désignation Produit                                                          | Référence | Conditionnement |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Triple V Capteur de volume pour Oxycon PRO, CPX, MOBILE, VYNTUS              | 982094    | U               |
| Cellule O2                                                                   | 923015    | U               |
| Manodétendeur pour Vyntus CPX                                                | 852909    | U               |
| Electrode avec Filtre intégré pour QUICKELS                                  | QN500     | Lot de 128      |
| Signal module                                                                | QN509     | Lot de 10       |
| Signal module ( <i>préciser la lettre</i> )                                  | QN510     | U               |
| Bague à Masque VO2 HANS RUDOLPH                                              | 602048    | U               |
| Harnais à Masque VO2 - Taille S - HANS RUDOLPH                               | 201492    | U               |
| Harnais à Masque VO2 - Taille M - HANS RUDOLPH                               | 201493    | U               |
| Harnais à Masque VO2 - Taille L - HANS RUDOLPH                               | 201494    | U               |
| Masque 7450 v2 - Taille XS - HANS RUDOLPH                                    | 669198    | U               |
| Masque 7450 v2 - Taille S - HANS RUDOLPH                                     | 669197    | U               |
| Masque 7450 v2 - Taille M - HANS RUDOLPH                                     | 669196    | U               |
| Masque 7450 v2 - Taille L - HANS RUDOLPH                                     | 669195    | U               |
| Filtre antibactérien & antiviral à embout Rond                               | 2800/22   | U               |
| Spray pour ECG à haute conductivité en flacon de 250ml                       | GESPG     | U               |
| Adaptateur (réducteur) pour embout filtre antibactérien 30mm sur pneumo 28mm | 3497-5    | U               |

## Cotation – Remboursement (source : www.aideaucodage.fr)

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                                                                                    | Arbre          | Tarif           | Activité(s) | Actif  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------|
| GLRP003 | <b>Epreuve d'effort</b> sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique avec mesure des gaz du sang (Epreuve d'effort simplifiée) ( <b>Gazométrie à l'effort</b> ). | <u>6.1.7.4</u> | <b>73,72 €</b>  | 1           | 2005 → |
| EQRPO02 | <b>Epreuve d'effort</b> sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique avec électrocardiographie discontinue et mesure de débit d'oxygène consommé ( <b>VO2</b> ). | <u>4.1.8</u>   | <b>106,55 €</b> | 1           | 2005 → |
| DKRP004 | <b>Epreuve d'effort</b> sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique avec électrocardiographie discontinue.                                                      | <u>4.1.8</u>   | <b>76,80 €</b>  | 1           | 2005 → |

# *Item 6*

## *Gazomètre*

# GAZOMETRE

Siemens

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|  | SIEMENS     | EPOC      | Analyseur des gaz du sang portatif |

| Désignation Produit                                                               | Référence | Conditionnement |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Carte test BUN & TCO2 (pH/Na+/Glu/pCO2/K+/Lac/pO2/Ca++/Crea/Hct/Cl-/TCO2/BUN)     | 10736515  | U               |
| TROCARD ROSE - Aiguille BD 40mm pour prélèvement <b>Capillaire</b>                | 114613    | U               |
| Capillaire 90ul                                                                   | 10736380  | Lot de 10       |
| Seringue d'aspiration héparine 3ml - Luer lisse - 70UI - en <b>Veineux</b>        | 10313293  | U               |
| Seringue d'aspiration héparine 1ml + Aiguille sécurité 23G – en <b>Artérielle</b> | 4629      | U               |
| Collecteur de déchets médicaux certifiée EN ISO 23907-1 : 2019 en 7L              | 162536    | U               |
| Imprimante EPOC ZEBRA Martel mobile printer Thermal Bluetooth 714                 | ZQ32      | U               |
| Rouleau papier imprimante                                                         | 10736408  | U               |

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                           | Arbre          | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|
| GLHF002 | Prélèvement de sang artériel avec <b>gazométrie</b> sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie. | <u>6.1.7.4</u> | 54,72 € | 1           | 2005 → |
| GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec <b>gazométrie</b> sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie. | <u>6.1.7.4</u> | 36,48 € | 1           | 2005 → |



<https://www.expresspoly.fr/produit/epoc-siemens-gaz-du-sang/>

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
|  | EMO         | I15       | Analyseur des gaz du sang idéal en cabinet |

| Désignation Produit                                                               | Référence  | Conditionnement |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Carte de réactif à usage unique                                                   | BG3        | U               |
| Carte de réactif à usage unique                                                   | BG10       | U               |
| Calibrant mensuel (50 tests ou 2 mois)                                            | CP50       | U               |
| TROCARD ROSE - Aiguille BD 40mm pour prélèvement <b>Capillaire</b>                | 114613     | U               |
| Adaptateur capillaire                                                             | GDS-ADA    | Lot de 100      |
| Tube capillaire pour gaz du sang                                                  | VIT/182413 | Lot de 250      |
| Seringue d'aspiration héparine 3ml - Luer lisse - 70UI - en <b>Veineux</b>        | 10313293   | U               |
| Seringue d'aspiration héparine 1ml + Aiguille sécurité 23G – en <b>Artérielle</b> | 4629       | U               |
| Collecteur de déchets médicaux certifiée EN ISO 23907-1 : 2019 en 7L              | 162536     | U               |
| Rouleau papier imprimante                                                         | RLX        | U               |

**Cotation – Remboursement** (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                           | Arbre          | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|
| GLHF002 | Prélèvement de sang artériel avec <b>gazométrie</b> sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie. | <u>6.1.7.4</u> | 54,72 € | 1           | 2005 → |
| GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec <b>gazométrie</b> sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie. | <u>6.1.7.4</u> | 36,48 € | 1           | 2005 → |



***Item 7***

***Echographie***

# ECHOGRAPHE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence  | Désignation produit                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DUOMED      | CLARIUS L7 | Echographe portable sans fil et connecté fourni avec sa tablette iPad – Affichage HD<br>Compatibilité IOS & Android- Profondeur 7 cm (4-13 Mhz)<br>Domaine d'emploi : <b>Vasculaire</b>   |
|  | DUOMED      | CLARIUS PA | Echographe portable sans fil et connecté fourni avec sa tablette iPad – Affichage HD<br>Compatibilité IOS & Android - Profondeur 40 cm (1-4 Mhz)<br>Domaine d'emploi : <b>Cardiaque</b>   |
|  | DUOMED      | CLARIUS C3 | Echographe portable sans fil et connecté fourni avec sa tablette iPad – Affichage HD<br>Compatibilité IOS & Android - Profondeur 35 cm (2-6 Mhz)<br>Domaine d'emploi : <b>Pneumologie</b> |

| Désignation Produit                                                | Référence   | Conditionnement |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Ventilateur pour une numérisation continue plus longue             | 99-03-00024 | U               |
| Coque antichoc pour tablette iPad Clarius avec poignée de maintien | 99-01-00001 | U               |
| Gel de contact BLEU pour échographie en 250ml                      | G-ECHO      | U               |

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                            | Arbre          | Tarif    | Activité(s) | Actif  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------|
| DZQM005 | <b>Echographie</b> – doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques au lit du malade. | <u>4.1.3.1</u> | 111,71 € | 1           | 2005 → |
| ZCQM008 | <b>Echographie</b> transcutanée de l'abdomen.                                                            | <u>7.1.3</u>   | 54,02 €  | 1           | 2005 → |
| GFQM001 | <b>Echographie</b> transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale.                  | <u>6.1.2</u>   | 37,05 €  | 1           | 2005 → |

# ***Item 8***

## ***Electrocardiographie***

# ELECTROCARDIOGRAPHE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spengler    | 260 003   | Electro-cardiographe <b>3 pistes</b><br>Ecran LCD couleur inclinable – visualisation des 12 dérivations – détecteur de PACEMAKER – enregistrement et impression de l'ECG                                                                                                        |
|                                                                                   | Spengler    | 260 006   | Electro-cardiographe <b>6 pistes</b><br>Ecran LCD couleur inclinable – visualisation des 12 dérivations – détecteur de PACEMAKER – enregistrement et impression de l'ECG                                                                                                        |
|                                                                                   | Spengler    | 260 012   | Electro-cardiographe <b>12 pistes</b><br>Ecran LCD couleur inclinable – visualisation des 12 dérivations – détecteur de PACEMAKER – enregistrement et impression de l'ECG – clavier Qwerty                                                                                      |
|  | CardioSecur | A00153    | Electro-cardiographe portable sans FIL PC-BLUETOOTH<br>Impression en 12 pistes avec <b>seulement 4 électrodes</b> .<br>Visualisation en temps réel sur l'écran PC ou Smartphone<br>Miniature et léger, faite un ECG sur votre PC portable ou Smartphone – <b>Compatible iOS</b> |
|  | Cardiopôst  | AFT1000   | <b>Nouveauté Holter ECG – sans licence</b><br>Léger et compact pour une acquisition simultanée de 12 Dérivations en surveillance continue jusqu'à 72 heures. Exportation des données via USB sur logiciel.<br>Batterie rechargeable intégrée.                                   |

| Désignation Produit                                                             | Référence  | Conditionnement |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Câble patient ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b>                                      | 260 020    | U               |
| 4 pinces membres pour ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b>                              | 260 021    | U               |
| 6 poires précordiales pour ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b> – 30mm                  | 260 022    | U               |
| 10 adaptateurs pour électrodes ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b> à bouton pression   | 260 023    | U               |
| Rouleau de papier 80mm X 20m pour ECG <b>Cardiomate 3</b>                       | 260 024    | U               |
| Rouleau de papier 110mm X 20m pour ECG <b>Cardiomate 6</b>                      | 260 025    | U               |
| Rouleau de papier 210mm X 20m pour ECG <b>Cardiomate 12</b>                     | 260 026    | U               |
| Spray pour ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b> à haute conductivité en flacon de 250ml | GESPG      | U               |
| Électrodes jetables à usage unique bouton pression ECG <b>Cardiomate 3-6-12</b> | WS00S-50   | 50 U            |
| Électrodes jetables à usage unique bouton pression <b>HOLTER ECG</b>            | L-00-S     | 25 U            |
| Licence de relecture et analyse pour le <b>HOLTER ECG</b>                       | Lic-holter | U               |

## Cotation – Remboursement (source : [www.aideaucodage.fr](http://www.aideaucodage.fr))

| Code    | Intitulé CCAM                                                                                                  | Arbre          | Tarif   | Activité(s) | Actif  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|
| DEQP003 | <b>Electrocardiographie</b> sur au moins 12 dérivations                                                        | <u>4.1.1.1</u> | 14,26 € | 1           | 2005 → |
| DEQP005 | <b>Électrocardiographie</b> sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | <u>4.1.1.1</u> | 77,01 € | 1           | 2005 → |

# *Item 9*

## *Instruments médicaux*

# OXYMETRES

| Equipement                                                                        | Fournisseur      | Référence  | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Creative Medical | Checkme    | Affichage Spo2 et fréquence cardiaque en temps réel et en continu. Conforme à la norme ISO internationale 80601. Oxymètre sous forme de bracelet, avec capteur à placer autour du pouce ou des autres doigts. Pour le suivi de la fréquence cardiaque et de la saturométrie (SpO2) sur votre Smartphone. |
|  | Med-accessories  | YK-80B     | <b><u>PREMIER PRIX</u></b><br>Oxymètre de pouls – écran OLED – Affichage graphique & numérique – livré avec dragonne – piles non inclus                                                                                                                                                                  |
|  | ChoiceMMed       | MD300C55   | <b><u>PEDIATRIQUE</u></b><br>Oxymètre de pouls – à partir de 1 an – écran LCD – 6 modes d’affichages – livré avec piles, dragonne & pochette de rangement                                                                                                                                                |
|  | ChoiceMMed       | MD300CI218 | <b><u>PREMIUM</u></b><br>Oxymètre de pouls – technologie Bluetooth – résistant à l’humidité et aux chocs – adapté à adulte, enfant & nourrisson – écran OLED – idéal doigts froids ou mauvaise circulation – livré avec piles, dragonne & étui rigide                                                    |
|  | RESMED           | NONIN3150  | Oxymètre de pouls avec enregistrement nocturne et relecture sur logiciel N'Vision. Fourni avec un logiciel de relecture, un capteur SpO2 taille M et son bracelet poignet velcro.                                                                                                                        |

| Désignation Produit                                                                   | Référence  | Conditionnement |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Logiciel N'VISION                                                                     | 3211-000   | U               |
| Câble USB connexion NONIN / PC                                                        | 7703-001   | U               |
| Adaptateur pour capteur <b>Flexible/Flexiwrap</b> - Connexion Oxymontre NONIN         | 7704-001   | U               |
| Extension en 1ml pour capteur <b>Flexible/Flexiwrap</b> - Connexion à 7704-001        | 6083-001   | U               |
| Capteur <b>Flexible</b> Nouveau-Né < 2kg <b>Réutilisable</b> – Livré avec 25 adhésifs | 8001J      | U               |
| Adhésif Flexi Wrap Nouveau-Né - Pied                                                  | 8001JFW    | 25 U            |
| Capteur <b>Flexible</b> Enfant 2 à 20 kg <b>Réutilisable</b> – Livré avec 25 adhésifs | 8008J      | U               |
| Adhésif Flexi Wrap Enfant – Orteil                                                    | 8008JFW    | 25 U            |
| Capteur <b>Flexible</b> Adulte > 20kg <b>Réutilisable</b> – Livré avec 25 adhésifs    | 8000J      | U               |
| Adhésif Flexi Wrap Adulte - Doigt                                                     | 8000JFW    | 25 U            |
| Capteur SpO2 souple - Taille S                                                        | 8000SS-WO2 | U               |
| Capteur SpO2 souple - Taille M                                                        | 8000SM-WO2 | U               |
| Capteur SpO2 souple - Taille L                                                        | 8000SL-WO2 | U               |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Nouveau-Né < 2 kg à <b>Usage Unique</b>                      | 6000CN     | 24 U            |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Pédiatrique 2 à 20 kg à <b>Usage Unique</b>                  | 6000CI     | 24 U            |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Enfant > 10 kg à <b>Usage Unique</b>                         | 6000CP     | 24 U            |
| Capteur <b>Flexiwrap</b> Adulte > 30 Kg à <b>Usage Unique</b>                         | 6000CA     | 24 U            |
| Sangle velcro poignet                                                                 | 7073323    | U               |
| Clapet seul compartiment piles                                                        | 7073972    | U               |
| Piles AAA rechargeables – 930 mAh - Eneloop Pro-blister                               | 7075542    | Lot de 4        |
| Chargeur de piles x4 Panasonic fourni avec 4 piles AA - 2500 mAh                      | 7075543    | U               |
| Chargeur de piles x8 Maha Powerex- compatible AA & AAA                                | 7072174    | U               |
| Sacoche de transport                                                                  | 8080120    | U               |

# TENSIOMETRES

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|
|  | Spengler                                                                                                                          | LIAN NANO            | <b><u>MECANIQUE</u></b><br>Tensiomètre à bras - MECANIQUE « haute précision » – Adulte – Taille M - Couleur Noir                                                                                                                             |                |               |              |                    |
|  | Spengler                                                                                                                          | MOBI                 | <b><u>MECANIQUE PREMIUM</u></b><br>Tensiomètre à bras - MECANIQUE « haute précision » - Ambidextre – Valve de décompression « haute sensibilité » - Tubulure Life Link - Adulte – Taille M – Couleur CARBONE                                 |                |               |              |                    |
|  | Spengler                                                                                                                          | TENSIONIC            | <b><u>ELECTRONIQUE</u></b><br>Tensiomètre à bras – ELECTRONIQUE – Entièrement automatique – Détecteur d’arythmie - Adulte – Taille M - Bleu                                                                                                  |                |               |              |                    |
|  | Spengler                                                                                                                          | 230220               | Tensiomètre <b>HOLTER TENSIONNEL OSCAR 2</b> avec enregistrement de prise de tension jusqu’à 48h<br>Logiciel de relecture sans licence<br>Application mobile pour permettre au patient d’agrémenter des informations durant l’enregistrement |                |               |              |                    |
|                                                                                   | <b><u>Cotation – Remboursement</u></b> <small>(source : <a href="http://www.aideaucodage.fr">www.aideaucodage.fr</a>)</small>     |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |              |                    |
|                                                                                   | <b>Code</b>                                                                                                                       | <b>Intitulé CCAM</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>Arbre</b>  | <b>Tarif</b> | <b>Activité(s)</b> |
| EQQP008                                                                           | Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] |                      |                                                                                                                                                                                                                                              | <u>4.1.2.2</u> | Remboursement | 1            | 2005 →             |

| Désignation Produit                                                             | Référence | Conditionnement |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Coton – Couleur MOTIFS – Taille XXS            | 334 139   | U               |
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Coton – Couleur MOTIFS – Taille XS             | 334 129   | U               |
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Coton – Couleur MOTIFS – Taille S              | 334 126   | U               |
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Nylon – Couleur NOIR – Taille M                | 334 116   | U               |
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Nylon – Couleur NOIR – Taille L                | 334 106   | U               |
| Brassard pour <b>LIAN NANO</b> – Nylon – Couleur NOIR – Taille XL               | 334 191   | U               |
| Brassard pour <b>MOBI</b> – Cuir – Couleur MOTIFS – Taille XS                   | 513 710   | U               |
| Brassard pour <b>MOBI</b> – Cuir – Couleur MOTIFS – Taille S                    | 513 711   | U               |
| Brassard pour <b>MOBI</b> – Cuir – Couleur GRIS – Taille M                      | 513 712   | U               |
| Brassard pour <b>MOBI</b> – Cuir – Couleur GRIS – Taille L                      | 513 713   | U               |
| Brassard pour <b>MOBI</b> – Cuir – Couleur GRIS – Taille XL                     | 513 714   | U               |
| Tubulure Life Link pour <b>MOBI</b>                                             | 513 720   | U               |
| Brassard pour <b>TENSIONIC</b> – Nylon – Couleur BLEU – Taille M/L – 22 à 42 cm | 527 464   | U               |
| Brassard pour <b>TENSIONIC</b> – Nylon – Couleur GRIS – Taille S – 16 à 24 cm   | 527 462   | U               |
| Brassard pour <b>TENSIONIC</b> – Nylon – Couleur GRIS – Taille XL – 32 à 48 cm  | 527 465   | U               |
| Adaptateur secteur pour <b>TENSIONIC</b>                                        | 527 184   | U               |
| Brassard Petit (18 – 26 cm) pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>               | 230811    | U               |
| Brassard Adulte (26 – 34 cm) pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>              | 230812    | U               |
| Brassard Extra Large (42 – 55 cm) pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>         | 230818    | U               |
| Housse de protection pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>                      | 230920    | U               |
| Ceinture Abdominale pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>                       | 230922    | U               |
| Bandoulière pour <b>HOLTER TENSIONNEL Oscar 2</b>                               | 552527    | U               |

# STETHOSCOPES

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spengler    | 507 710   | Stéthoscope DOUBLE PAVILLON « Pulse II » - Adapté au brassard – Pavillon en aluminium – Bague anti-froid – Membrane haute résolution                                                                                             |
|  | Spengler    | 506 010   | <b><u>ACOUSTIQUE D'EXCEPTION</u></b><br>Stéthoscope SIMPLE PAVILLON « Cardio Prestige II » - Adapté au brassard – Pavillon en acier Inox – Bague anti-froid – Membrane flottante multi fréquence                                 |
|  | Spengler    | 506 011   | <b><u>ACOUSTIQUE D'EXCEPTION</u></b><br>Stéthoscope DOUBLE PAVILLON « Cardio Prestige II » - Adapté au brassard – Pavillon en acier Inox – Bague anti-froid – Membrane flottante multi fréquence – Pavillon adulte & pédiatrique |
|  | Spengler    | 507 704   | Stéthoscope SIMPLE PAVILLON « Pulse II » <b>PEDIATRIQUE</b> - Adapté au brassard – Pavillon en aluminium – Bague anti-froid – Membrane haute résolution                                                                          |

# THERMOMETRE

| Equipement                                                                        | Fournisseur | Référence | Désignation produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spengler    | SP3110    | Un véritable jeu d'enfant, 1 bouton, appuyez et le résultat s'affiche.<br>La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisées.<br>Avec son mode « arrêt automatique » et son « indicateur de batterie faible », pas de mauvaise surprise lors de vos consultations. |



## **DONNÉES TECHNIQUES**

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : – 5 cm
- Unité de mesure : C° / F°
- Plage d'affichage : 32,0°C – 43,0°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : 0,2°C
- Mémoire : 30 mémoires
- Temps de mesure : Inférieur à 1 seconde
- Ecran : LCD

## **AUTRES INFORMATIONS**

- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 (H)
- Mise hors tension automatique économie d'énergie
- Piles livrées avec (2 x piles AAA)

***Item 10***

***Hygiène***

***&***

***Entretien***

# HYGIENE & ENTRETIEN

| Produit                                                                                                                                                                  | Fournisseur | Produit | Fournisseur                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | EXPRESSPOLY | 450F    | Essuie main en bobine                                                                                                        |
|                                                                                         | EXPRESSPOLY | 105796  | Compresse de gaze NON STERILES – Lot de 100 par paquet – 5 X 5 cm – 8 plis / 17 fils                                         |
|                                                                                                                                                                          | EXPRESSPOLY | 117421  | Compresse de gaze NON STERILES – Lot de 100 par paquet – 7,5 X 7,5 cm – 8 plis / 17 fils                                     |
| <br> | EXPRESSPOLY | 182782  | Sparadrap Micropore 3M – 1,25cm X 9,14ml – SANS Dévidoir – <b>Vendu à l'unité</b> – Conditionné en <b>Boite de 24 unités</b> |
|                                                                                                                                                                          | EXPRESSPOLY | 181545  | Sparadrap Micropore 3M – 2,50cm X 9,14ml – SANS Dévidoir – <b>Vendu à l'unité</b> – Conditionné en <b>Boite de 12 unités</b> |
|                                                                                                                                                                          | EXPRESSPOLY | 112470  | Sparadrap Micropore 3M – 2,50cm X 9,14ml – AVEC Dévidoir – <b>Vendu à l'unité</b> – Conditionné en <b>Boite de 12 unités</b> |
|                                                                                                                                                                          | EXPRESSPOLY | 181575  | Sparadrap Micropore 3M – 5,00cm X 9,14ml – SANS Dévidoir – <b>Vendu à l'unité</b> – Conditionné en <b>Boite de 6 unités</b>  |
|                                                                                                                                                                          | EXPRESSPOLY | 8065889 | Sparadrap Micropore 3M – 5,00cm X 9,14ml – AVEC Dévidoir – <b>Vendu à l'unité</b> – Conditionné en <b>Boite de 6 unités</b>  |
|                                                                                       | EXPRESSPOLY | 7072173 | Lingettes désinfectantes – Lot de 120 lingettes par boite                                                                    |

# HYGIENE & ENTRETIEN

| Produit                                                                             | Fournisseur | Produit | Fournisseur                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | EXPRESSPOLY | 25885   | Sparadrap multi-extensible 3M Medipore Liner 10cm X 10ml                                          |
|    | EXPRESSPOLY | 27831   | Bande adhésive Hypafix transparent double barrière 5cm X 10ml                                     |
|    | EXPRESSPOLY | 29128   | Ecouillons NON Stériles de 15cm                                                                   |
|    | EXPRESSPOLY | 51188   | Anti-adhésif pour pansement en Flacon de 125ml - Gilbert                                          |
|    | EXPRESSPOLY | 110070  | SURFA'SAFE PREMIUM rouge en 750ml<br>Détergeant et Désinfectant de surface et dispositif médicaux |
|   | EXPRESSPOLY | 110068  | ANIOSPRAY SURF 29 en 1L<br>Désinfectant surface                                                   |
|  | EXPRESSPOLY | 8096486 | ANIOSYME X3 en 1L<br>Détergeant et Désinfectant instruments                                       |
|  | EXPRESSPOLY | 184986  | STERANIOS 2% en 5L<br>Désinfectant de haut niveau                                                 |
|  | EXPRESSPOLY | 110065  | SURFANIOS PREMIUM en 5L<br>Détergeant et Désinfectant sols et surface                             |



Nous vous assistons au sein de votre laboratoire du sommeil pour effectuer vos scoring

## Nos offres

- ⇒ PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT AU SCORING.
- ⇒ PRESTATIONS DE SCORING RECURRENT.
- ⇒ CREATION ET MISE EN PRATIQUE D'UN RAPPORT PERSONNALISE.
- ⇒ ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE SUR DES CAS COMPLEXES.

## Notre service

Nous vous accompagnons à distance sur vos enregistrements du sommeil :

- ⇒ PRISE EN MAIN A DISTANCE AVEC AUTHENTIFICATION PAR LOGIN ET MOT DE PASSE LORS DE CHAQUE CONNEXION POUR ASSURER UNE SECURITE LORS DU SCORING.
- ⇒ CONNEXION A UN SERVEUR (ACCES VPN) – UNE CONNEXION EST ETABLIE AVEC LE SERVEUR DE L'ETABLISSEMENT OU SUR LE POSTE DE RELECTURE AVEC DEFINITION D'UN DOSSIER PRECIS DES ENREGISTREMENTS A SCORER.
- ⇒ DEPOT DE VOTRE ENREGISTREMENT SUR [WWW.EXPRESSOM.FR](http://WWW.EXPRESSOM.FR) – NOUS NOUS CHARGERONS DU SCORING ET DE LA CREATION DU RAPPORT PDF. CELUI-CI DEVIENT DISPONIBLE AU TELECHARGEMENT DANS VOTRE ESPACE « MON COMPTE ».

# NOTATIONS - REMARQUES

---

